キレイライン矯正について

リニューアル版

2025_09　Ver. 5.0

キレイライン矯正
KIREILIGN ORTHODONTICS

© SheepMedical Co., Ltd.

キレイライン矯正
KIREILIGN ORTHODONTICS

キレイライン矯正に関する情報

1-1. キレイライン矯正で使用する 矯正・保定 装置
1-2. アライナーの装着期間
1-3. 契約の種類
1-4. 初回予約以降の流れ
1-5. 初回来院時の対応
1-6. スタッフ用アライナー
1-7. 資料採得の目的（矯正前と矯正後の変化を記録）
1-8. 口腔内写真
1-9. 顔貌写真
1-10. レントゲン（パントモ）
1-11. 資料採得_口腔内3Dスキャン
1-12. 資料採得_印象
1-13. 契約時の説明
1-14. コース料金
1-15. オプション料金
1-16. アタッチメント付与のタイミング
1-17. 初回セット
1-18. トライアルマウスピース
1-19. キレイライン矯正 1回の周期
1-20. キレイライン矯正 5回コースの周期
1-21. キレイライン矯正 10回コースの周期（一括納品）
1-22. キレイライン矯正 15回コースの周期（一括納品）
1-23. キレイライン矯正 10回コース+拡大床併用の周期（3.0㎜拡大の場合）
1-24. キレイライン矯正10回コース+拡大床併用の周期（4.0㎜拡大の場合）
1-25. キレイライン矯正10回コース+拡大床併用の周期（5.0㎜拡大の場合）
1-26. キレイライン矯正15回コース+拡大床併用の周期（3.0㎜拡大の場合）
1-27. キレイライン矯正15回コース+拡大床併用の周期（4.0㎜拡大の場合）
1-28. キレイライン矯正15回コース+拡大床併用の周期（5.0㎜拡大の場合）
1-29. キレイライン矯正10回コースの周期（分割納品）
1-30. キレイライン矯正15回コースの周期（分割納品）
1-31. キレイラインフル40回コースの周期
1-32. アライナーの納品形態
1-33. 口腔内スキャンデータ/石膏模型が必要なタイミング
1-34. 各商品の発注書・必要資料・納品物 ①
1-35. 各商品の発注書・必要資料・納品物 ②
1-36. 納期
1-37. 発注書 兼 技工指示書の記入例
1-38. 解約（分割発注の場合のみ対象）
1-39. 送患料（広告システム利用料）
1-40. 転院
1-41. キレイラインKIDS　初回来院時と装置受取り時の対応
1-42. キレイラインKIDS　来院スケジュール

© SheepMedical Co., Ltd.

キレイライン矯正
KIREILIGN ORTHODONTICS

キレカルシステムに関する情報

2-1. 初期設定

2-2. 診療日の設定

2-3. 特別営業日の設定

2-4. 長期休業の設定

2-5. ブロック枠の設定

2-6. 時間帯のブロック設定

2-7. 初回検診ご予約フォーム画面

2-8. 初回検診ご予約フォームとキレカルの連携

2-9. 患者様からの予約・変更・キャンセル通知

2-10. 初回検診ご予約フォーム以外から予約された患者様の登録

2-11. 予約登録（初回検診ご予約フォーム以外の予約/再診予約）

2-12. 予約日/時間の変更 ①

2-13. 予約日/時間の変更 ②

2-14. 予約キャンセル処理

2-15. コメント機能（患者情報メモ）

2-16. アクティビティ

2-17. 問診票入力案内の送信

2-18. 未契約理由の入力方法

2-19. 未契約理由の入力方法 ①

2-20. 未契約理由の入力方法 ②

2-21. 来院予定表の印刷

2-22. 技工指示書の印刷 ①

2-23. 技工指示書の印刷 ②

2-24. 発注の流れ（技工指示書、写真、レントゲン、口腔内スキャンのアップロード）

2-25. 発注の流れ（スキャンデータ/石膏模型の送付）

2-26. iTero®でのスキャンデータ送信方法

2-27. iTeroエレメント®による資料採得

2-28. iTero®スキャンデータの出力とキレカルへのアップロード方法

2-29. 発注状況の確認

2-30. 納品物の検収

2-31. 納品物の検収 （誤って「納品完了」にステータス変更した場合の対応方法）

2-32. 3Dシミュレーション、セットアップデータの確認方法

2-33. 契約前/追加シミュレーションの納品

2-34. IPR量、拡大量の確認方法

2-35. サポートサイトへのアクセス

© SheepMedical Co., Ltd.

キレイライン矯正
KIREILIGN ORTHODONTICS

拡大床について

3-1. 取扱説明
3-2. 装着方法
3-3. 外し方
3-4. 拡大方法
3-5. 拡大スケジュール表（患者様用）
3-6. 拡大量の計測方法
3-7. 拡大量の確認方法
3-8. リベース

© SheepMedical Co., Ltd.

キレイライン矯正
KIREILIGN ORTHODONTICS

Appendix


口腔内3Dスキャン（NG例1）
口腔内3Dスキャン（NG例2）
顔貌写真（NG例1）
顔貌写真（NG例2）
顔貌写真（NG例3）
口腔内写真（NG例1）
スキャン時の注意と空隙量記載の重要性
口腔内写真（NG例2）
口腔内写真（NG例3）
口腔内写真（NG例4）
アタッチメント付与
〔初回検診ご予約フォーム〕からの予約以降のメール配信タイミング
空隙について

© SheepMedical Co., Ltd.


1. キレイライン矯正に関する情報

1-1. キレイラインで使用する 矯正・保定 装置

アライナー

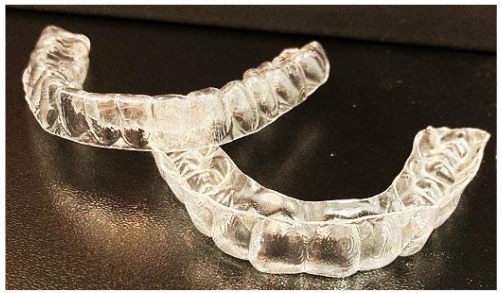

拡大床

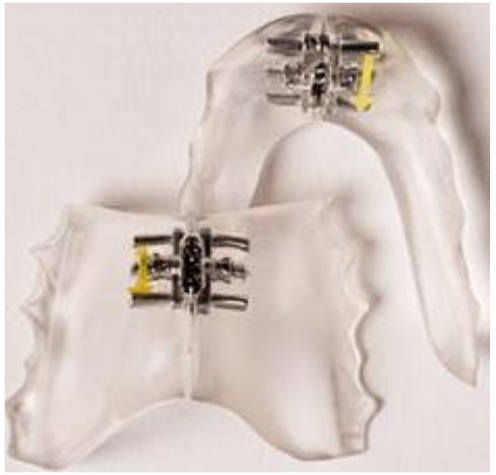

クリアリテーナー



バイトプレーン付
拡大床



© SheepMedical Co., Ltd.

1-2. アライナーの装着期間

アライナー単独の場合

1枚：2週間

拡大床を併用する場合

1枚：5週間

拡大床を使用する場合は１枚のアライナーで
1mm広げる設計（週1回の拡大で0.2mm）

© SheepMedical Co., Ltd.


1-3. 契約の種類

- キレイライン矯正　1回
- キレイライン矯正　5回 コース
- キレイライン矯正 10回 コース
- キレイライン矯正 15回 コース
- キレイラインフル 40回 コース
- トライアルマウスピース
- キレイラインKIDS

© SheepMedical Co., Ltd.

キレイライン矯正
KIREILIGN ORTHODONTICS

1-4. 初回予約以降の流れ

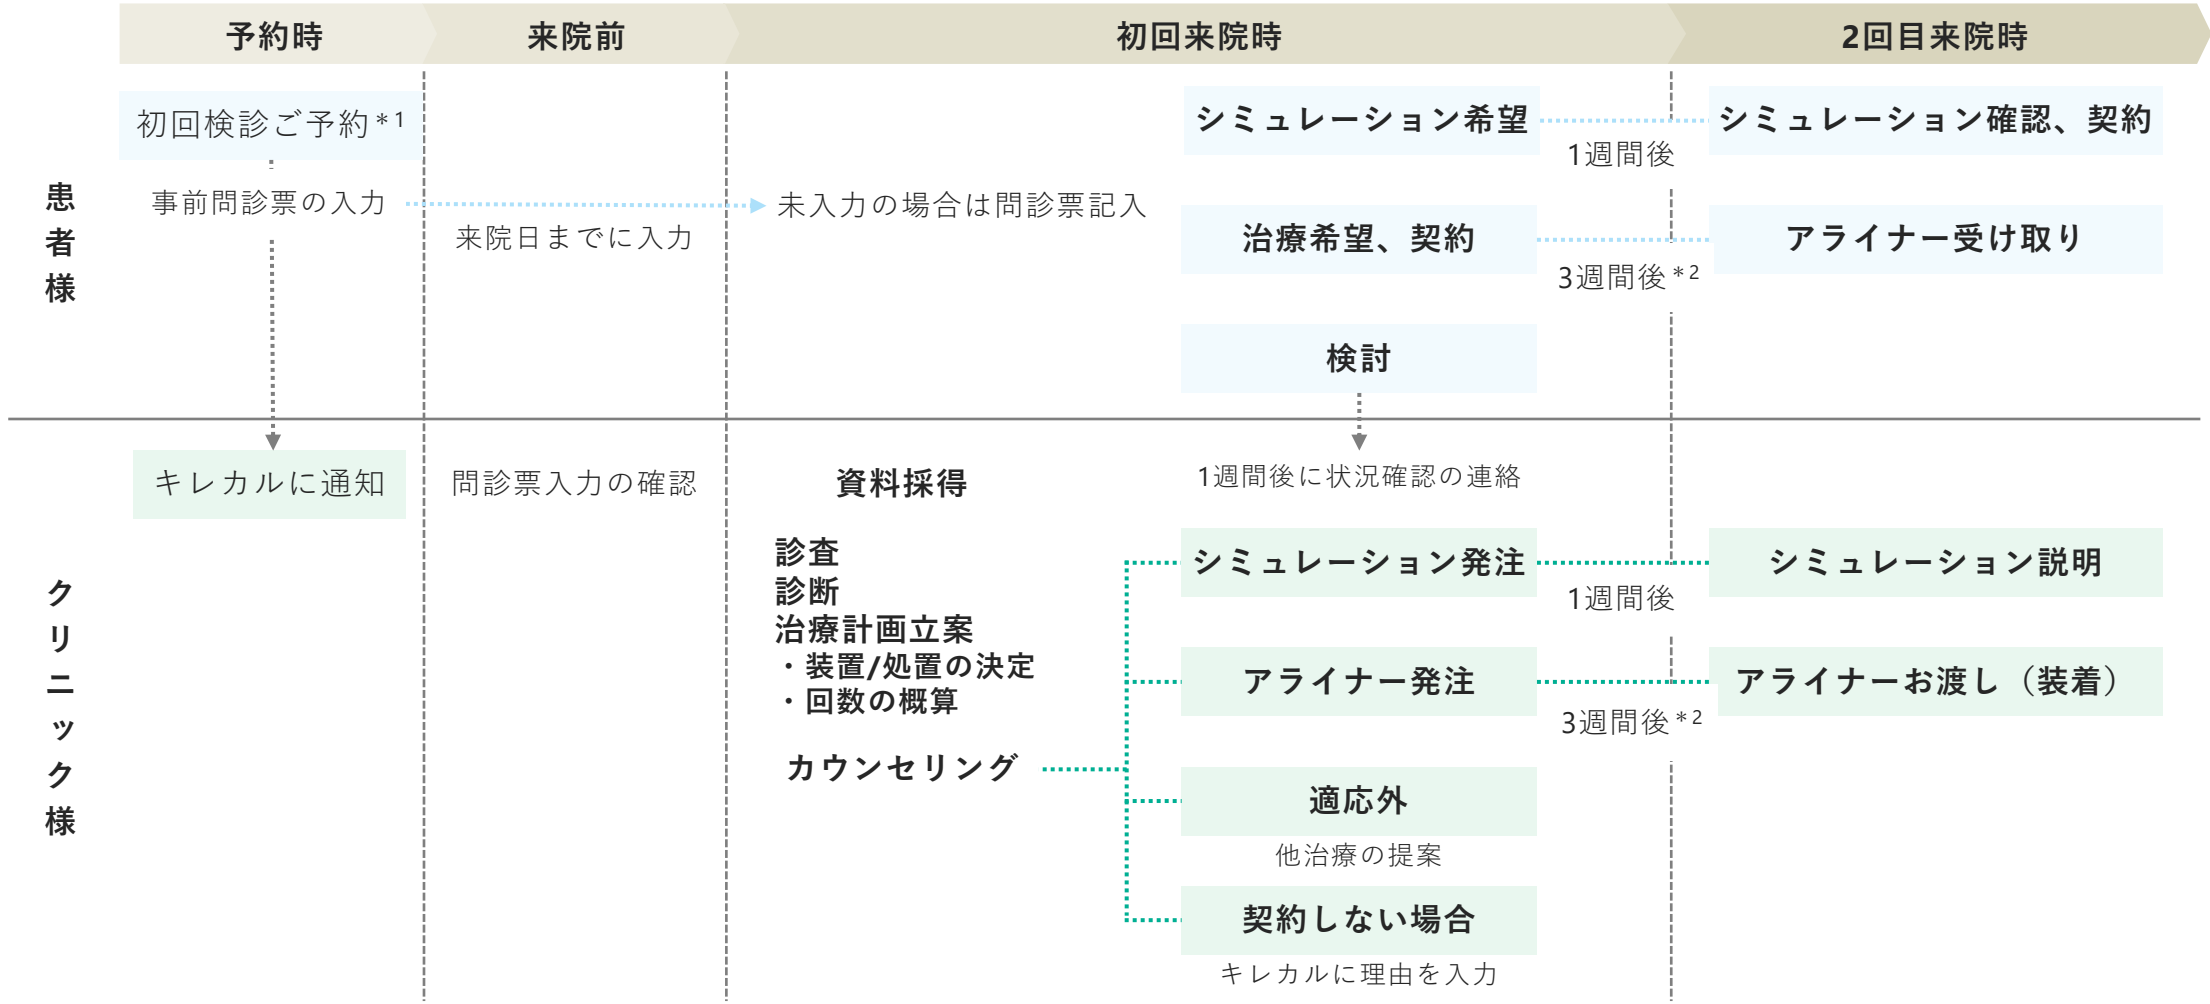

＊1 初回検診ご予約フォーム　https://lp.kireilign.com/yoyaku

＊2 トライアルマウスピース契約の場合のみ納期 2 週間

© SheepMedical Co., Ltd.

1-5. 初回来院時の対応

スケジュール（約60分）

流れと目安時間

資料採得 (約20分)	診査診断 (約10分)	カウンセリング・契約 (約30分)
レントゲン（パントモ） 写真撮影 • 顔貌写真（3枚） • 口腔内写真（5枚） 口腔内3Dスキャンまたは印象・咬合採得 キレイラインフルは上記＋CBCT、セファロ	通常の矯正治療の診断に準ずる • キレイライン矯正対象かの見極め • 回数の概算を算出	• アライナーの説明 （スタッフがアライナーを装着して説明） • コースの説明 • 治療期間・金額の説明 • 装置の説明 契約 • 動画視聴 • 同意書記入 • 解約説明書記入（分割発注の場合のみ対象）
	契約前シミュレーション • 契約前シミュレーションを発注	

© SheepMedical Co., Ltd.

1-6. スタッフ用アライナー

目的

実際にスタッフが口腔内に装着して、見た目（目立たない）の印象・発音 等を患者様にお伝えすることでより契約につながりやすくする。

発注できるもの

- トライアルマウスピース
- キレイライン矯正　1回、5回／10回／15回コース
- 拡大床
- リテーナー

料金

無料（Fixリテーナーは有料、クリアリテーナーは2枚目から有料、アライナーはトータル15回までは無料ですが16回目から有料）

発注時の技工指示書 記載方法

- 技工指示書の〔クリニックスタッフ〕にチェックする
- その他、患者様と同様の記載をする（必ず必要コースにチェックする）

その他、注意事項

- Dr.による診査診断は必須です。
- 初回キレイライン矯正発注時およびリテーナー発注時（動的治療終了時）にはレントゲン、口腔内写真、顔貌写真、口腔内スキャンデータ／石膏模型が必要です。

© SheepMedical Co., Ltd.

1-7. 資料採得の目的（矯正前と矯正後の変化を記録）

顔貌写真

「正貌」「スマイル」「側貌」

の３枚



口腔内写真

「正面」「側方左右」「咬合面上下」


の５枚



レントゲン

「パントモ」

通常の撮影方法で撮影したデータ

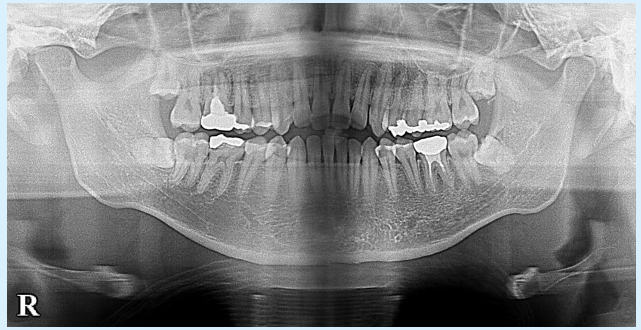

治療開始の「初回発注」と動的治療終了の「リテーナー発注」時に
技工指示書とあわせて上記資料のアップロードをお願いします※


※規格外のデータは再提出が必要となる場合があります。必要な情報を確認できない場合はセットアップに反映できかねます。

© SheepMedical Co., Ltd.

1-8. 顔貌写真（頭頂から鎖骨までの証明写真程度の範囲を撮影）

正貌


対称性と口腔周囲筋の状態
を記録する

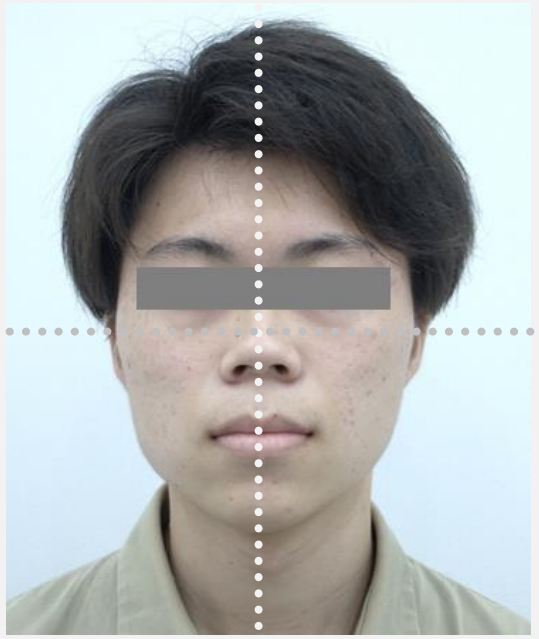

患者の目線は正面
中心咬合位で軽くかみ、軽く唇を閉じる

スマイル

顔面正中に対する上顎の正中
を記憶する

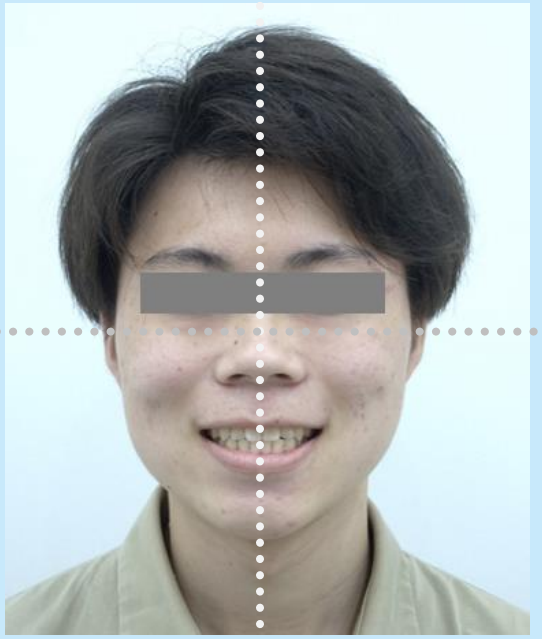

患者の目線は正面
口角を上げ、上顎前歯を見せてスマイル

側貌

Profile、E-line
を記録する



患者は向かって右に向かせる、目線は正面
中心咬合位で軽くかみ、軽く唇を閉じる

✅ 背景に余計な物なし ✅ 顔の輪郭に装飾や髪なし ✅ ピンボケ/影/白飛びなし ✅ フランクフルト平面と床面平行 ✅ カメラレンズは顔に対して垂直正面

エプロンもできるだけ外してください。

© SheepMedical Co., Ltd.

キレイライン矯正
KIREILIGN ORTHODONTICS


1-9. 口腔内写真（寝かせた状態で口角鈎を使用し、必要に応じて2人で撮影）

正面
OBの状態や正中
を記録する




中心咬合位でかませる
口角鈎は横に引っ張る

左右側方
臼歯関係(6番近心まで)
を記憶する

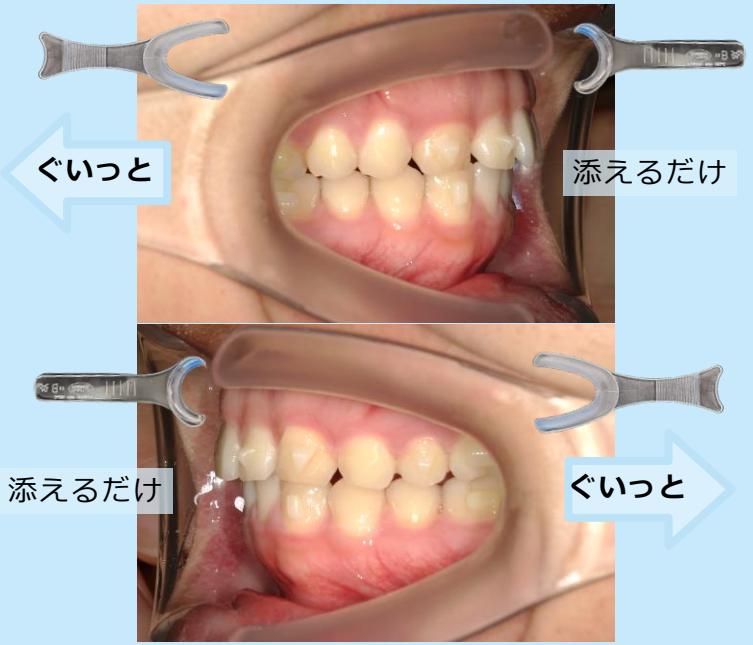

顔を真横に向け中心咬合位でかませる
深いU字形口角鈎で横に引っ張る

上下咬合面
ミラーに映した7-7歯列弓
を記録する

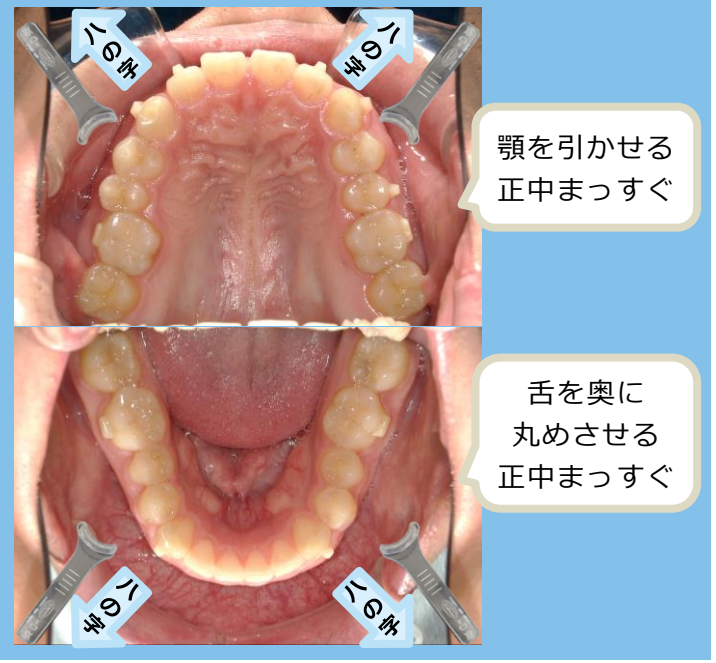

口を大きく開かせミラーを入れる
小さい口角鈎でハの字に引っ張る

✅ 顎は地面と平行 ✅ 適切な口角鈎を使用 ✅ ピンボケ/影/白飛びなし ✅ カメラレンズは咬合平面/ミラー面に対して垂直正面 ✅ ミラーに水滴や傷なし

見本は口角鈎の使い方が分かる範囲の画像を載せていますが、歯と歯肉以外はトリムした状態でアップロードをお願いします。


© SheepMedical Co., Ltd.

1-10. レントゲン（パントモ）（正しい位置でかませ、通常の方法で撮影）

対称性と口腔周囲筋の状態歯槽骨の状態や処置歯・埋伏歯等の確認

根の形態や並行性、下顎頭の形態

を記録する

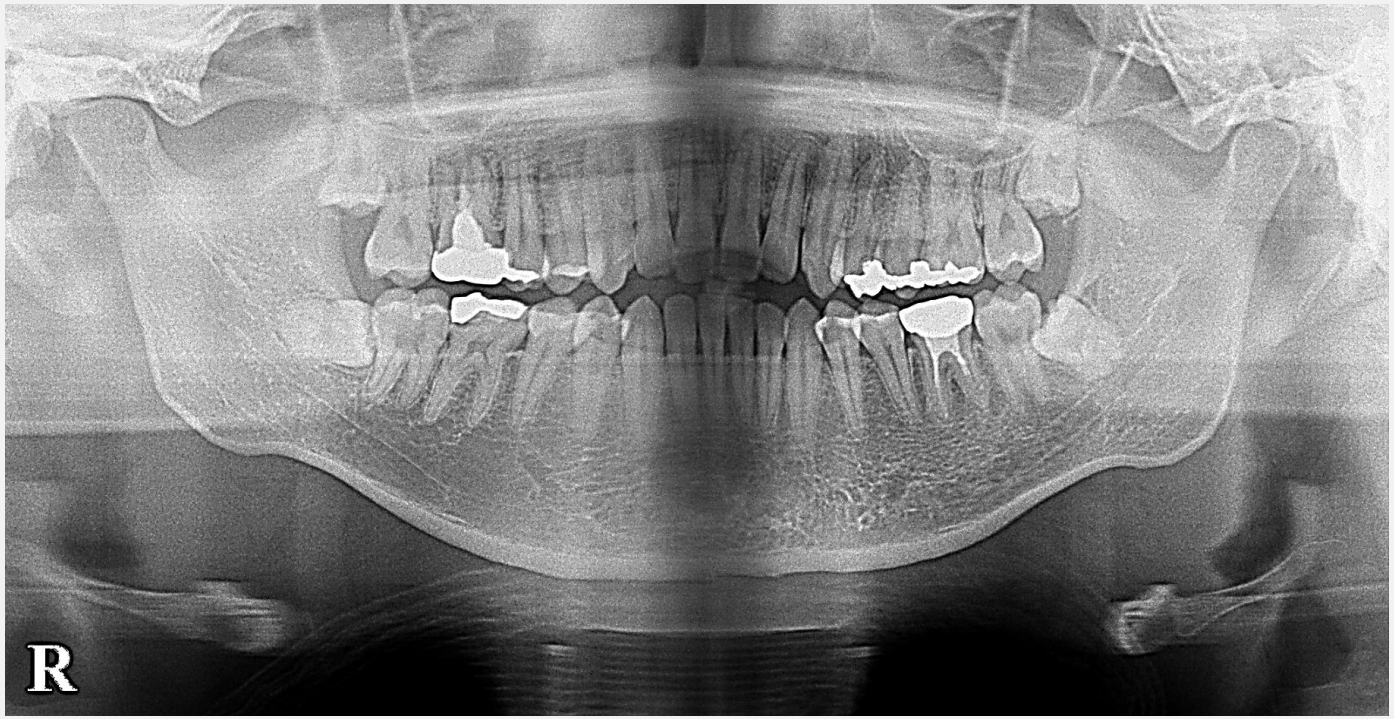

操作方法はメーカー説明書にしたがってください


© SheepMedical Co., Ltd.

1-11. 資料採得_口腔内3Dスキャン

上顎は口蓋側まで、


下顎は舌側歯槽部までスキャンする（歯頸部から+5.0㎜の範囲まで採れていること）

正面

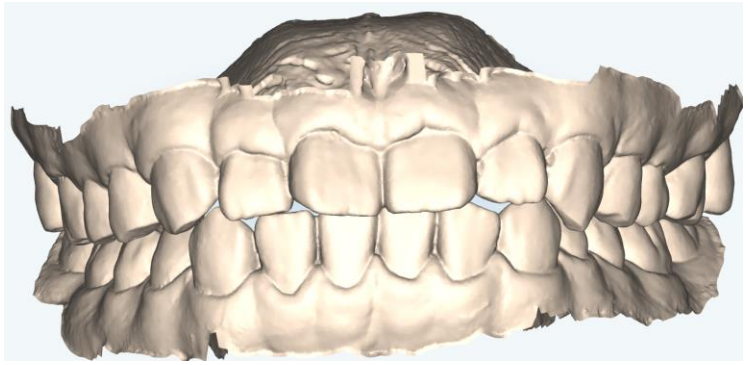


中心咬合位

上顎

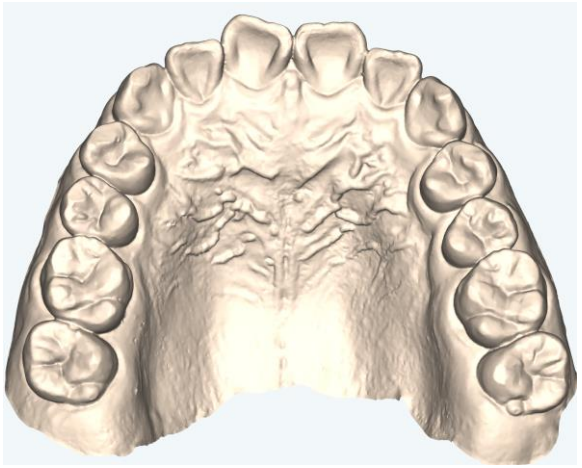

口蓋側までスキャン

下顎

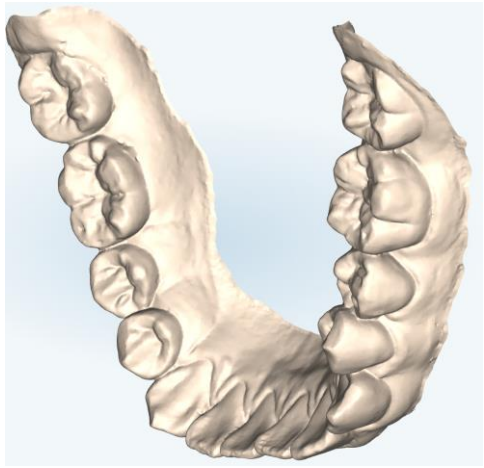

舌側歯槽部までスキャン

拡大床の製作には口蓋側が必要です（採れていない場合は再提出いただきます）

デンチャーやブラケット・fix(ワイヤー)リテーナーなどは外した状態でスキャンしてください。

なお、現在装着されているデンチャーは、キレイライン矯正終了後再製作が前提となります。

© SheepMedical Co., Ltd.

1-12. 資料採得_印象

口腔内3Dスキャナーを導入していない場合は石膏模型をお送りください。


アルジネート印象

時間の経過で寸法変化するため採得後はすぐに**硬石膏**を注ぎ石膏模型を製作する

咬合採得（バイト）も必須

印象のポイント

- 歯頚部、最後臼歯、上顎口蓋面等の**印象面が切れていない**
- 表面に**気泡がない**（上顎の場合は口蓋の気泡にも注意）
- **歯頚部から+5.0㎜**の範囲まで採れている
- **小帯が印記**されている

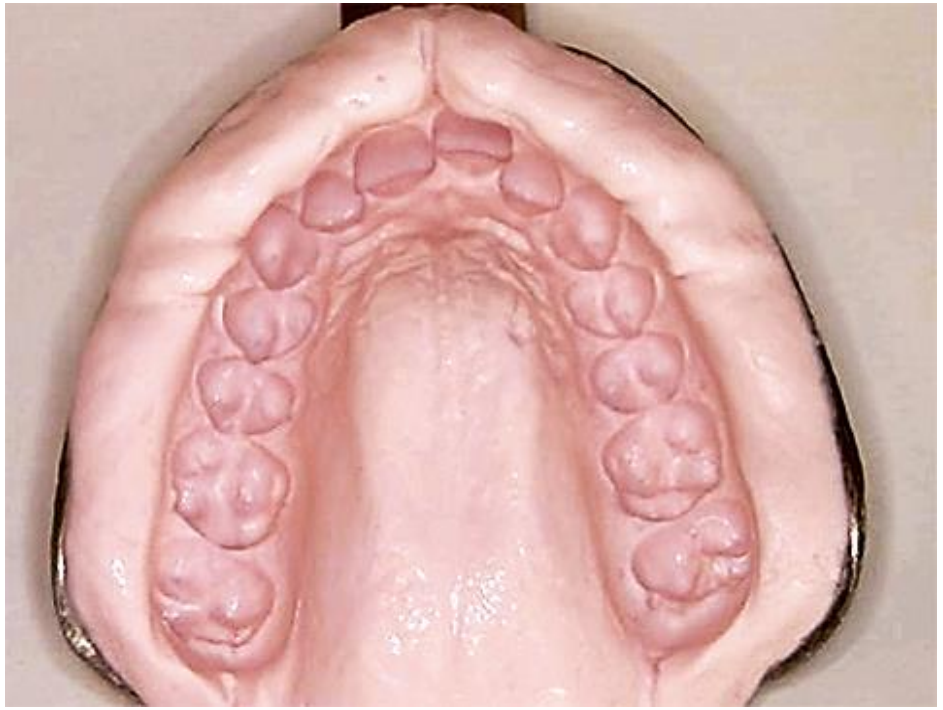

デンチャーやブラケット・fix(ワイヤー)リテーナーなどは外した状態で印象採得してください。
なお、現在装着されているデンチャーは、キレイライン矯正終了後再製作が前提となります。

© SheepMedical Co., Ltd.

キレイライン矯正
KIREILIGN ORTHODONTICS

1-13. 契約時の説明

患者様視聴動画　同意書記入前に必ずご視聴いただく動画です		
矯正治療の基礎知識	IPRについて	拡大床について （拡大床併用者様のみ視聴）
		
約８分	約２分	約２分

© SheepMedical Co., Ltd.

1-14. コース料金

価格はすべて税込み（上下セット）です

商品名		初回限定特典 ホワイトニングジェル	患者様価格	技工料
キレイライン矯正 1回	初回	○	¥ 44,000	¥ 14,300
	追加			
キレイライン矯正 5回コース	初回	○	¥ 198,000	¥ 71,500
	追加			
キレイライン矯正 10回コース	初回	○	¥ 330,000	¥ 143,000
	追加			
キレイライン矯正 15回コース	初回	○	¥ 462,000	¥ 214,500
	追加			
キレイラインフル 40回コース	初回	○	¥ 548,900	¥ 237,600
	追加10回		¥ 55,000	¥ 33,000
キレイラインKIDS	初回*1		¥ 165,000	¥ 39,600
	追加		¥ 13,200	¥ 6,600
トライアルマウスピース			¥ 990	無料提供
クリアリテーナー （バーチャルパワーチェーン対応のリテーナー*2も同価格）		上下セット 1組	¥ 22,000	¥ 11,000
		上下セット 2組	自由価格*3	¥ 17,600
		上下セット 3組	自由価格*4	¥ 24,200

＊1　1年の保証期間は廃止となりました
＊2　ワイヤー矯正では、動的治療終了前に歯と歯の間にあるわずかな隙間を閉じるためにパワーチェーン（鎖状のエラスティック）を使用します。パワーチェーンと同様のスペース閉鎖を、リテーナーで対応できるようになりました。マウスピース矯正でのシミュレーションは実際の移動および治療結果とは異なる場合があり、契約ステージ終了後に 0.2 mm～0.3 mm 程のわずかな隙間が残ってしまうこともあります。この程度の空隙はスキャンデータでは確認できないこともあるため、リテーナーで空隙閉鎖をご希望の場合は閉鎖部位と空隙量を技工指示書にご記入ください。ただし、移動量が大きい、捻転を含む移動の場合は従来通り追加アライナーに変更していただく場合がございます。
＊3　参考価格　¥ 33,000　（下限価格は¥ 22,000とします）　　＊4　参考価格　¥ 44,000　（下限価格は¥ 22,000とします）

1-15. オプション料金

料金表作成は こちらより承ります

オプション		患者様価格	技工料	備考
契約前シミュレーション	2パターン	自由価格	¥13,200	
追加シミュレーション	1パターン	自由価格	¥13,200	
アタッチメントテンプレート	上下顎/片顎	-	-	追加料金なし（アライナー料金に含まれます）
バイトランプ付アライナー	上顎	-	-	追加料金なし（アライナー料金に含まれます）
拡大床	片顎	¥22,000	¥11,000	
バイトプレーン付 拡大床	上顎	¥22,000	¥11,000	
fix（ワイヤー）リテーナー	片顎	¥33,000	¥5,500	
アライナー ・ リテーナー再製作	片顎	自由価格	¥4,400	参考価格：¥6,600〜

価格はすべて税込みです

© SheepMedical Co., Ltd.

1-16. アタッチメント付与のタイミング


アタッチメント（ATT）テンプレートが納品されたタイミングで歯面に付与してください。

注意事項

バイトランプにはATT付与をしないでください。

ホワイトニングジェルはATT付与中は使用しないでください。

ATTテンプレートには、右の写真のように
咬合面に〔Tmp〕の文字が刻印されています。

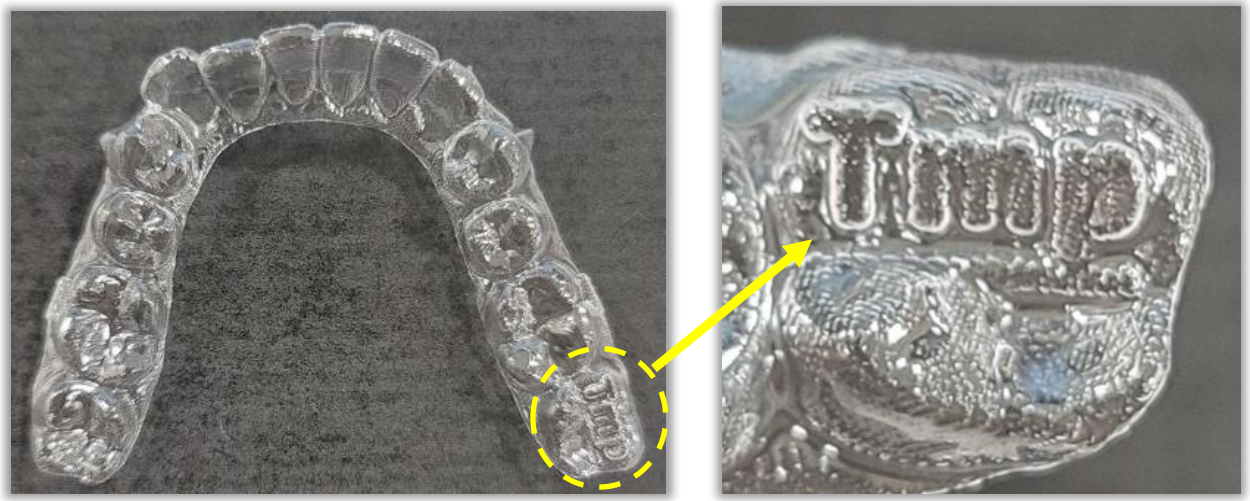

アタッチメント付与に関してはP99参照

© SheepMedical Co., Ltd.

キレイライン矯正
KIREILIGN ORTHODONTICS

1-17. 初回セット

初回セットの内容
① ケース  どちらかお選びいただきます イエローはKIDS専用
② チューイー 
③ リムーバー 

クリニック様でご準備ください
④ ホワイトニング剤

最初にクリニック様へお届けする数量（アライナーは除く）
12セット（①～③を各12）

初回セット①～④について

- ご提供は初回契約時のみ

  （トライアルマウスピースの契約は「リムーバー」のみ）


  （キレイラインKIDSの契約は「ケース」のみ）
- 転売禁止

初回セットの追加申込は右のQR
またはこちらから承ります

© SheepMedical Co., Ltd.

1-18. トライアルマウスピース

トライアルマウスピース装着期間：１週

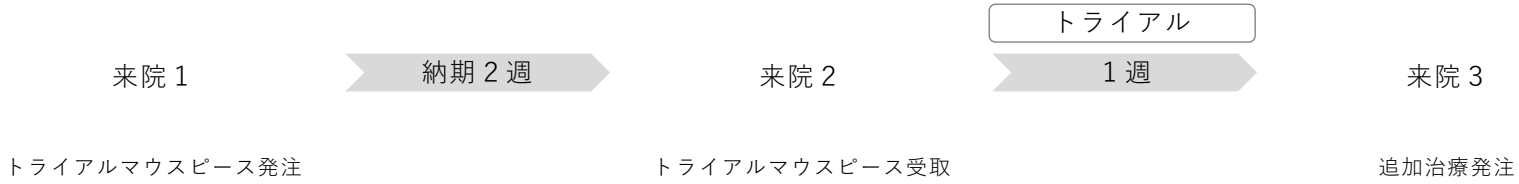


実施する内容		実施するタイミング
診査		各来院毎
診断・治療計画立案		来院１
資料採得	・レントゲン	来院１
	・顔貌写真	来院１
	・口腔内写真	来院１
	・口腔内スキャン（印象採得）	来院１

© SheepMedical Co., Ltd.

キレイライン矯正
KIREILIGN ORTHODONTICS

1-19. キレイライン矯正 1回の周期

治療期間（アライナー装着期間）：2週

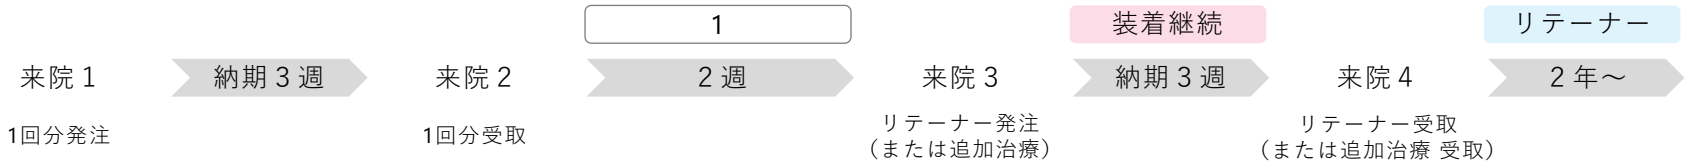

実施する内容		実施するタイミング
診査		各来院毎
診断・治療計画立案		来院 1
資料採得	・レントゲン	来院 1，3（リテーナー発注時のみ）
	・顔貌写真	来院 1，3（リテーナー発注時のみ）
	・口腔内写真	来院 1，3（リテーナー発注時のみ）
	・口腔内スキャン（印象採得）	来院 1，3


治療終了時（来院3）の診査結果の対応については治療ガイドラインの「Checklist」を活用してください

© SheepMedical Co., Ltd.

キレイライン矯正
KIREILIGN ORTHODONTICS

1-20. キレイライン矯正 5回コースの周期

最短の治療期間（アライナー装着期間）：10週（約2.5ヶ月）

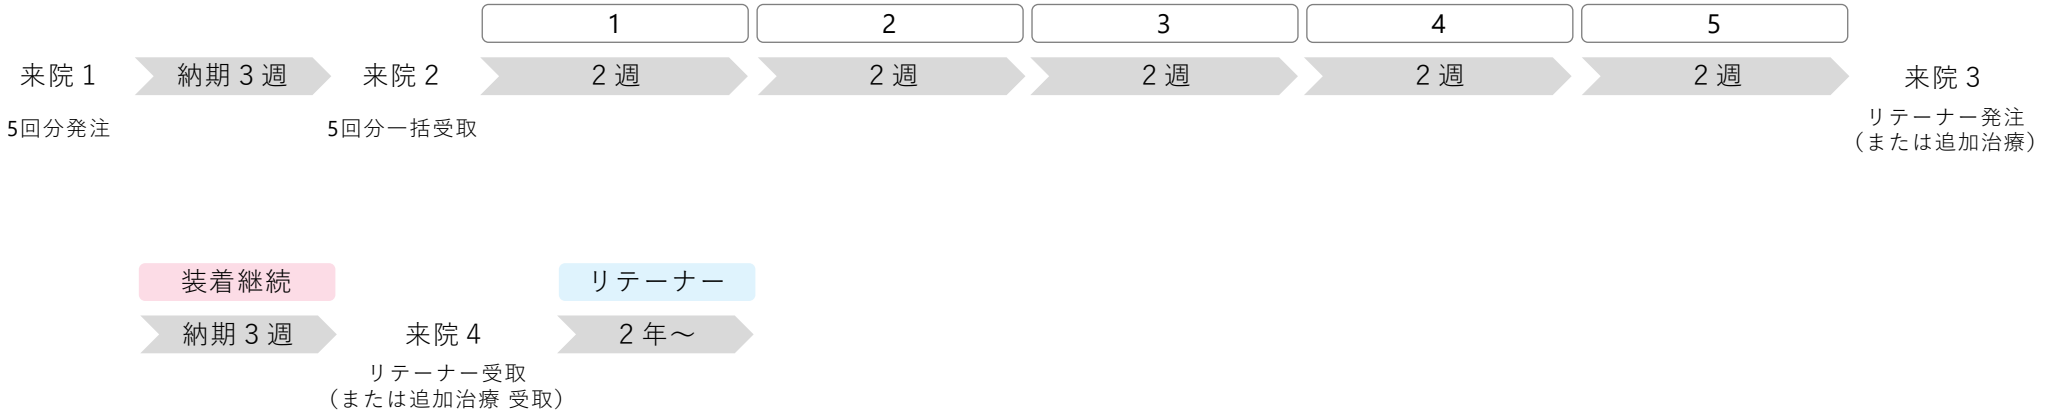

実施する内容		実施するタイミング
診査		各来院毎
診断・治療計画立案		来院 1
資料採得	・レントゲン	来院 1，3（リテーナー発注時のみ）
	・顔貌写真	来院 1，3（リテーナー発注時のみ）
	・口腔内写真	来院 1，3（リテーナー発注時のみ）
	・口腔内スキャン（印象採得）	来院 1，3


治療終了時（来院3）の診査結果の対応については治療ガイドラインの「Checklist」を活用してください

© SheepMedical Co., Ltd.

キレイライン矯正
KIREILIGN ORTHODONTICS

1-21. キレイライン矯正 10回コースの周期（一括納品）

最短の治療期間（アライナー装着期間）：20週（約5ヶ月）

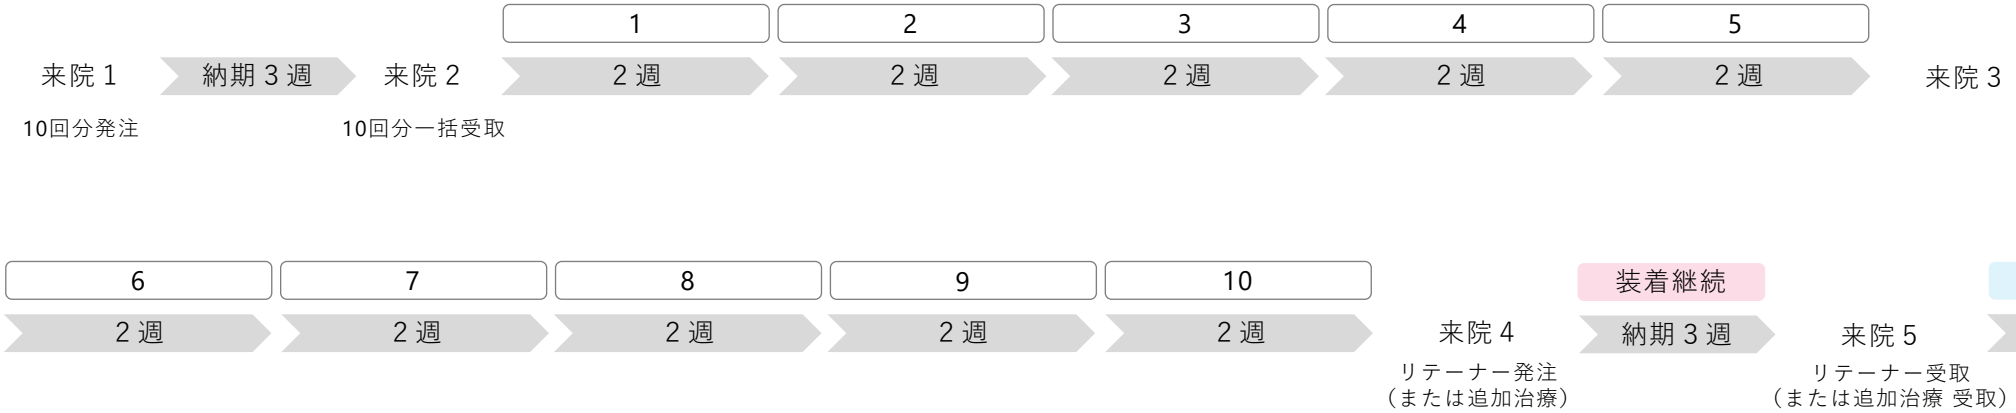

実施する内容		実施するタイミング
診査		各来院毎
診断・治療計画立案		来院 1
資料採得	・レントゲン	来院 1，4（リテーナー発注時のみ）
	・顔貌写真	来院 1，4（リテーナー発注時のみ）
	・口腔内写真	来院 1，4（リテーナー発注時のみ）
	・口腔内スキャン（印象採得）	来院 1，4


治療中（来院3）、治療終了時（来院4）の診査結果の対応については治療ガイドラインの「Checklist」を活用してください

© SheepMedical Co., Ltd.

キレイライン矯正
KIREILIGN ORTHODONTICS

1-22. キレイライン矯正 15回コースの周期（一括納品）

最短の治療期間（アライナー装着期間）：30週（約7ヶ月）

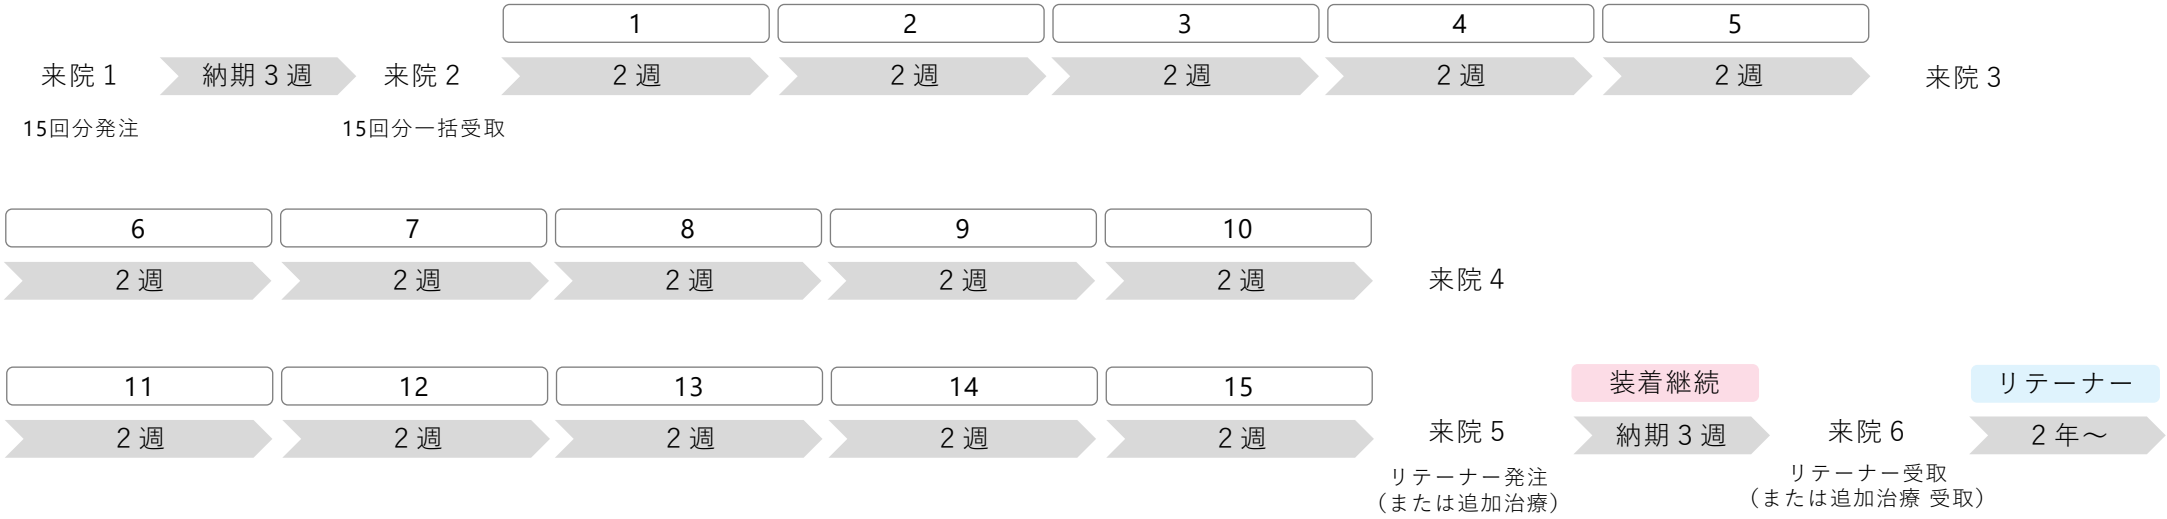

実施する内容		実施するタイミング
診査		各来院毎
診断・治療計画立案		来院 1
資料採得	・レントゲン	来院 1，5（リテーナー発注時のみ）
	・顔貌写真	来院 1，5（リテーナー発注時のみ）
	・口腔内写真	来院 1，5（リテーナー発注時のみ）
	・口腔内スキャン（印象採得）	来院 1，5


治療中（来院3, 4）、治療終了時（来院5）の診査結果の対応については治療ガイドラインの「Checklist」を活用してください

© SheepMedical Co., Ltd.

キレイライン矯正
KIREILIGN ORTHODONTICS

1-23. キレイライン矯正 10回コース+拡大床併用の周期（3.0㎜拡大の場合）

最短の治療期間（アライナー装着期間）：32週（約7.5ヶ月）

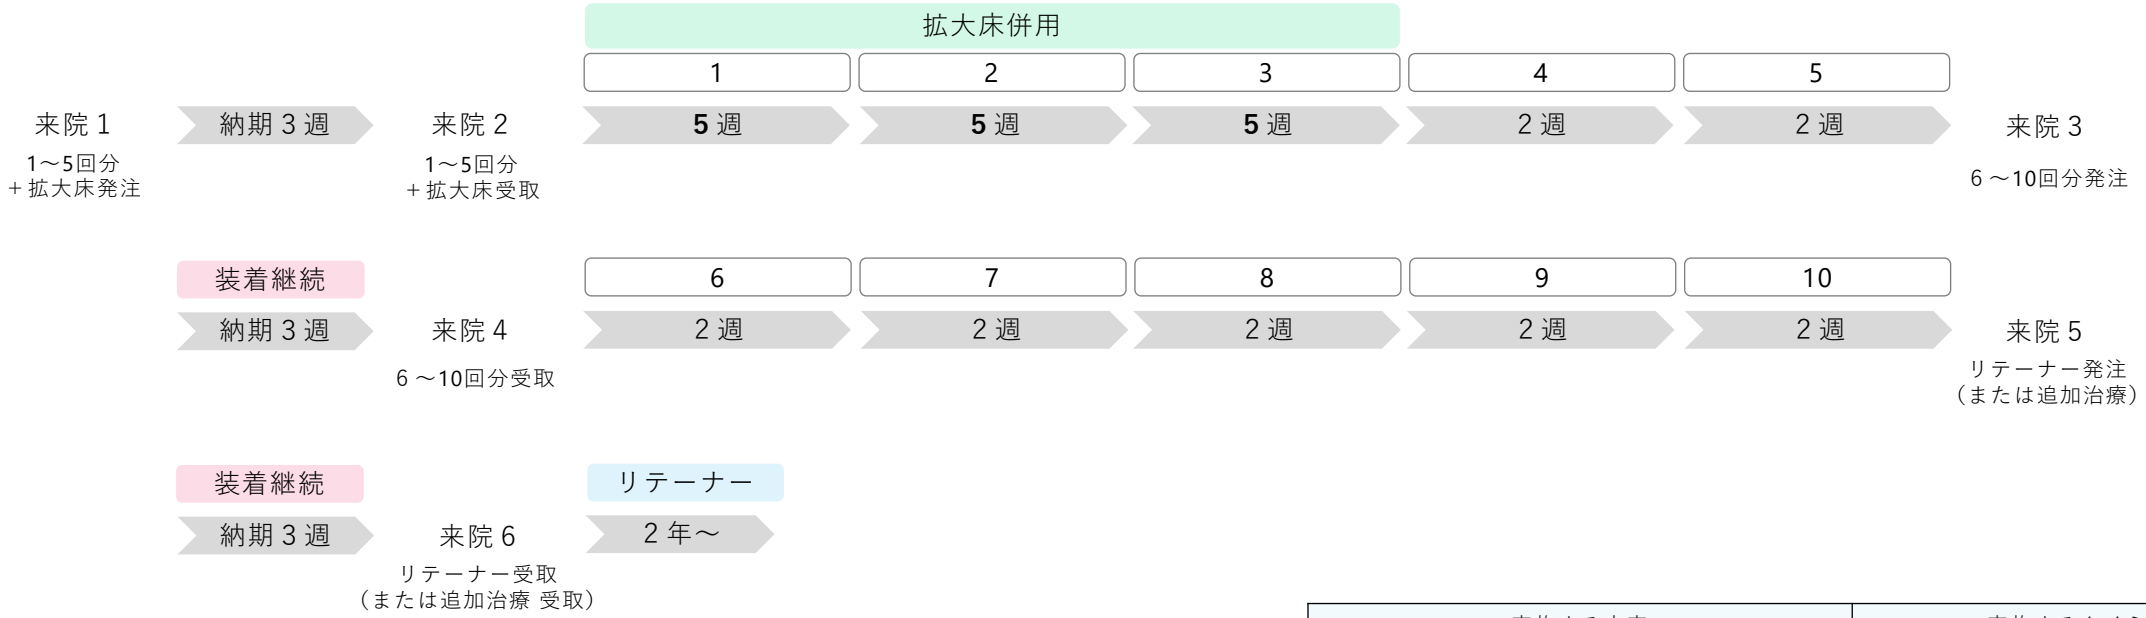

実施する内容		実施するタイミング
診査		各来院毎
診断・治療計画立案		来院 1
資料採得	・レントゲン	来院 1，5（リテーナー発注時のみ）
	・顔貌写真	来院 1，5（リテーナー発注時のみ）
	・口腔内写真	来院 1，5（リテーナー発注時のみ）
	・口腔内スキャン（印象採得）	来院 1，3，5

拡大床併用中はクリニック判断で来院回数は変更可能です


治療中（来院3, 4 ）、治療終了時（来院5）の診査結果の対応については治療ガイドラインの「Checklist」を活用してください

© SheepMedical Co., Ltd.

キレイライン矯正
KIREILIGN ORTHODONTICS

1-24. キレイライン矯正 10回コース+拡大床併用の周期（4.0㎜拡大の場合）

最短の治療期間（アライナー装着期間）：35週（約8ヶ月）

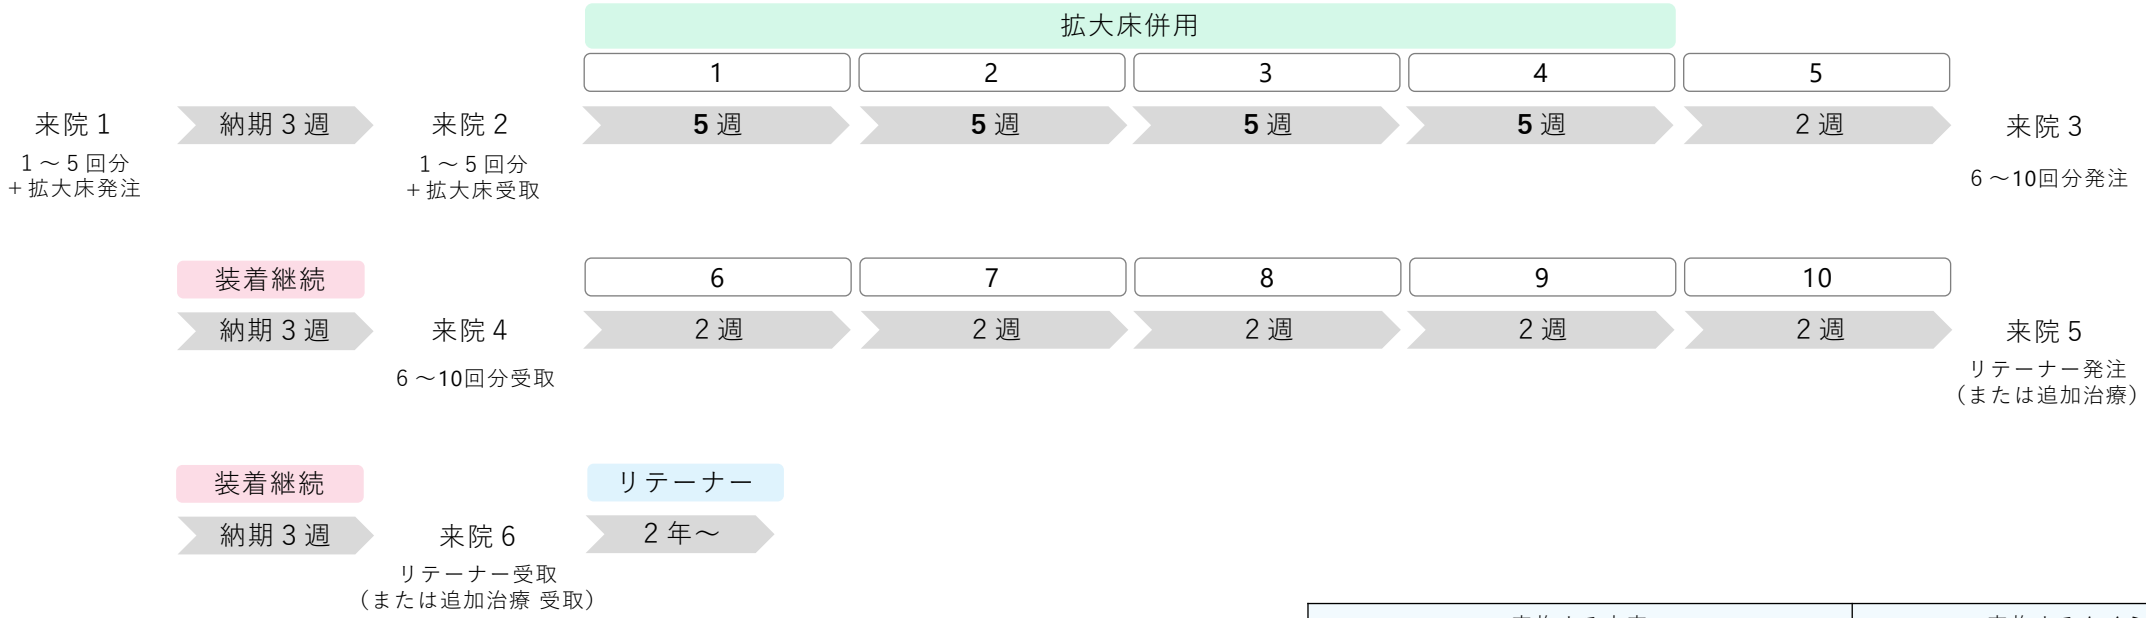

実施する内容		実施するタイミング
診査		各来院毎
診断・治療計画立案		来院 1
資料採得	・レントゲン	来院 1，5（リテーナー発注時のみ）
	・顔貌写真	来院 1，5（リテーナー発注時のみ）
	・口腔内写真	来院 1，5（リテーナー発注時のみ）
	・口腔内スキャン（印象採得）	来院 1，3，5

拡大床併用中はクリニック判断で来院回数は変更可能です


治療中（来院3, 4 ）、治療終了時（来院5）の診査結果の対応については治療ガイドラインの「Checklist」を活用してください

© SheepMedical Co., Ltd.

キレイライン矯正
KIREILIGN ORTHODONTICS

1-25. キレイライン矯正 10回コース+拡大床併用の周期（5.0㎜拡大の場合）

最短の治療期間（アライナー装着期間）：38週（約9ヶ月）

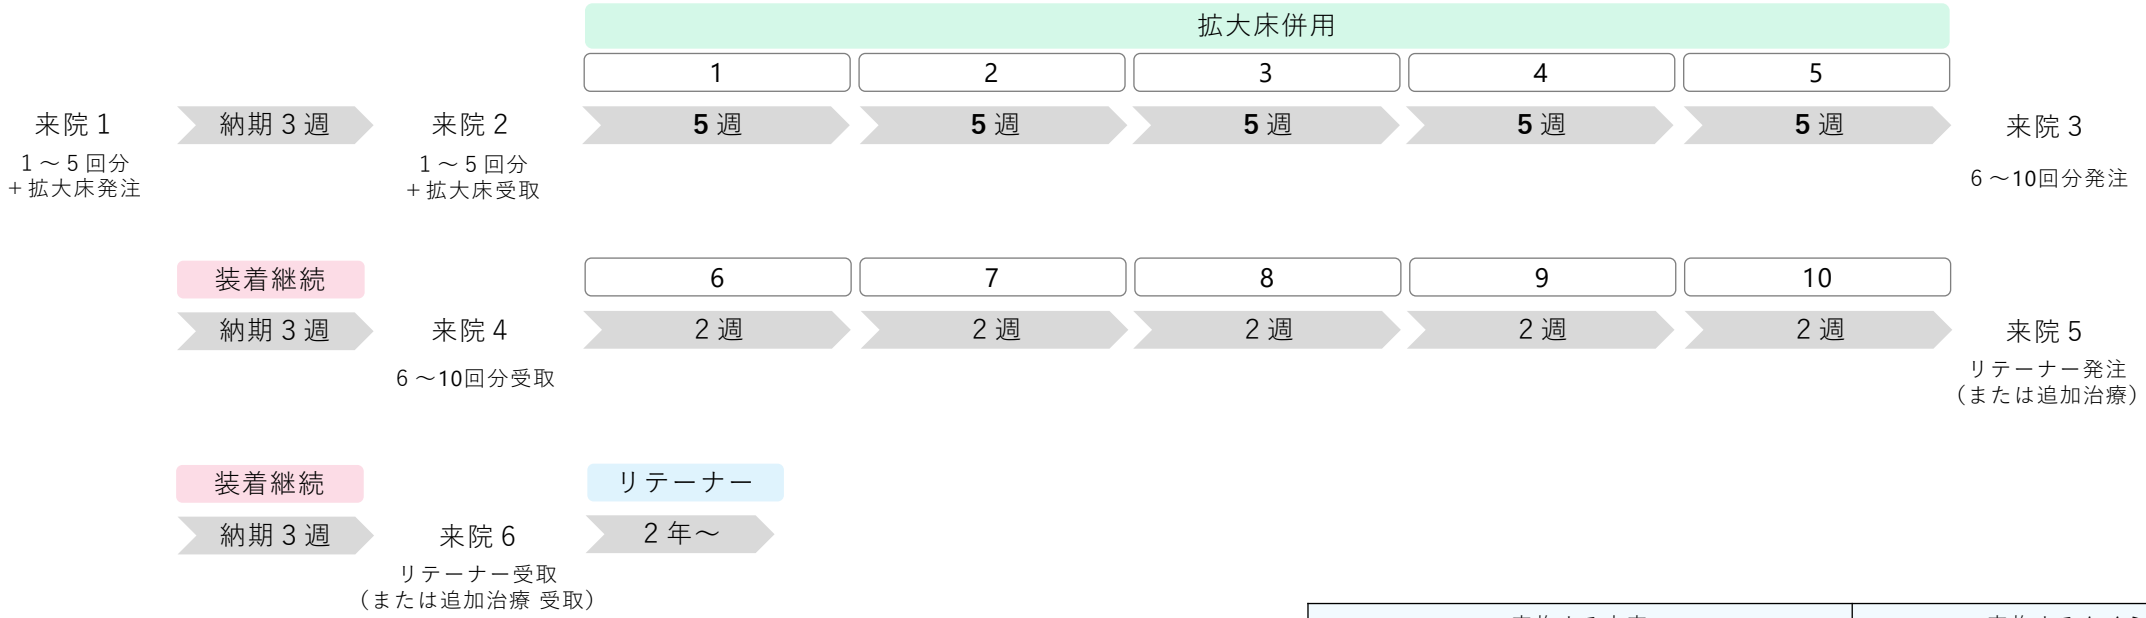

実施する内容		実施するタイミング
診査		各来院毎
診断・治療計画立案		来院 1
資料採得	・レントゲン	来院 1，5（リテーナー発注時のみ）
	・顔貌写真	来院 1，5（リテーナー発注時のみ）
	・口腔内写真	来院 1，5（リテーナー発注時のみ）
	・口腔内スキャン（印象採得）	来院 1，3，5

拡大床併用中はクリニック判断で来院回数は変更可能です


治療中（来院3, 4 ）、治療終了時（来院5）の診査結果の対応については治療ガイドラインの「Checklist」を活用してください

© SheepMedical Co., Ltd.

キレイライン矯正
KIREILIGN ORTHODONTICS

1-26. キレイライン矯正 15回コース+拡大床併用の周期（3.0㎜拡大の場合）

最短の治療期間（アライナー装着期間）：45週（約10ヶ月）

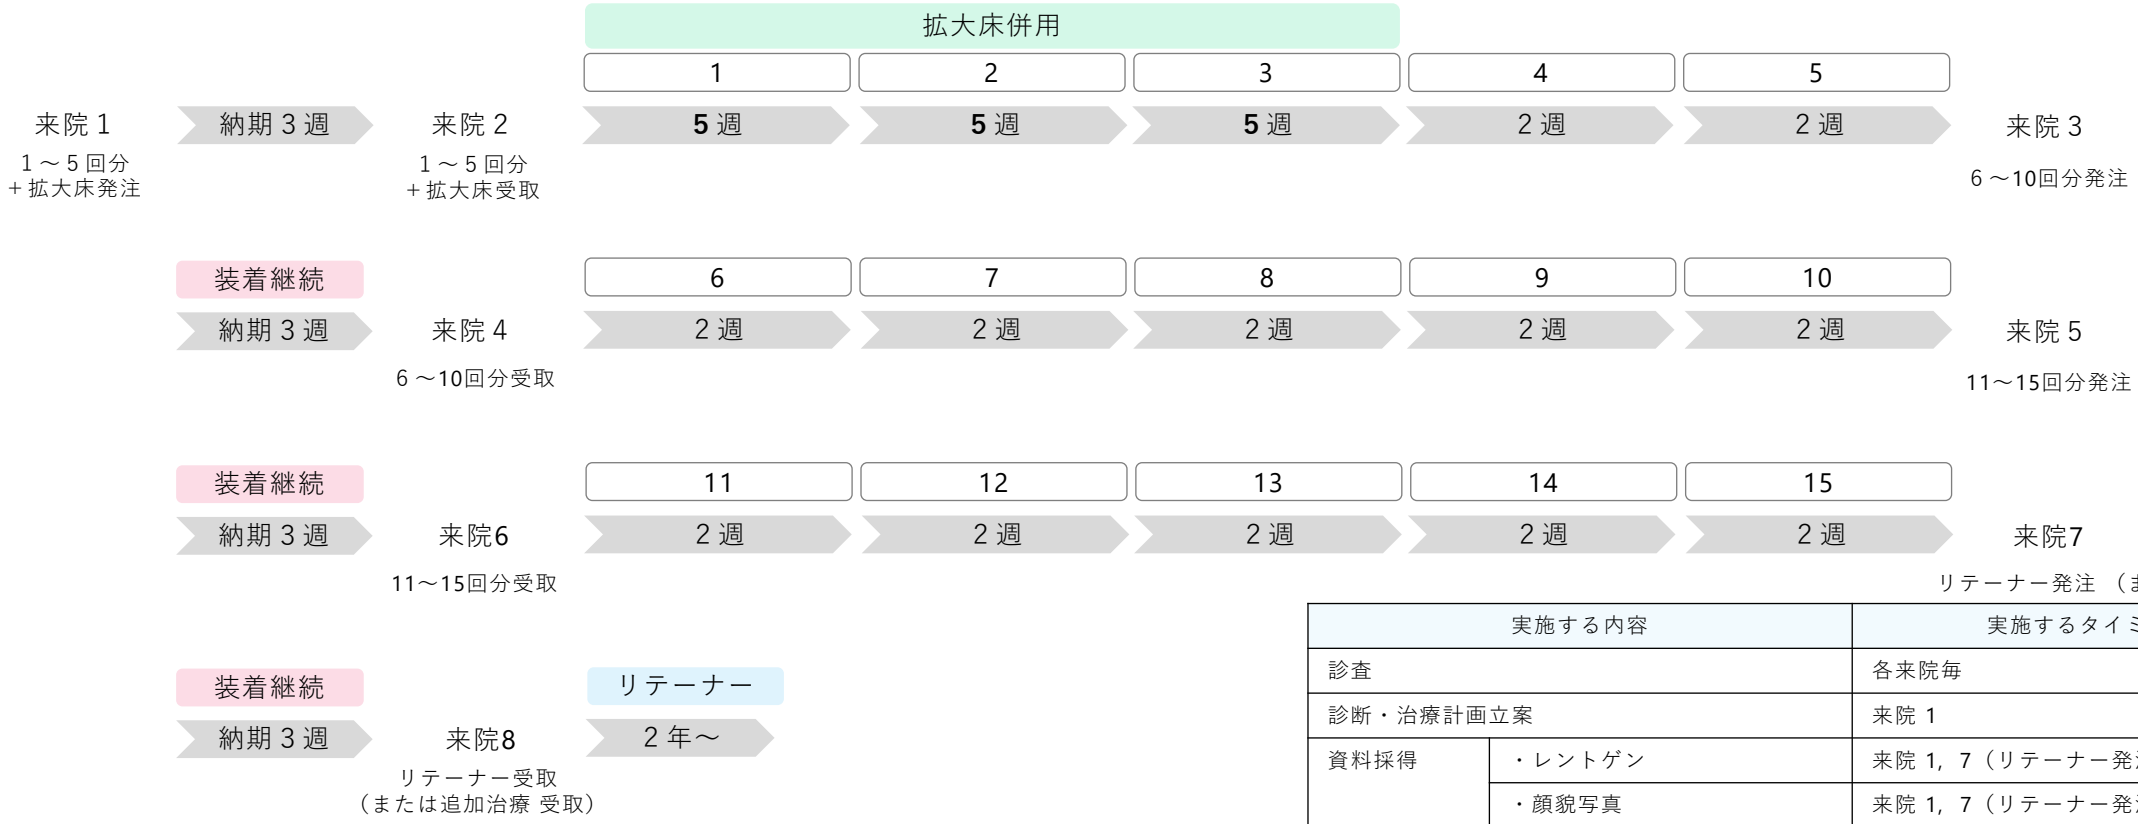

実施する内容		実施するタイミング
診査		各来院毎
診断・治療計画立案		来院 1
資料採得	・レントゲン	来院 1，7（リテーナー発注時のみ）
	・顔貌写真	来院 1，7（リテーナー発注時のみ）
	・口腔内写真	来院 1，7（リテーナー発注時のみ）
	・口腔内スキャン（印象採得）	来院 1，3，5，7

拡大床併用中はクリニック判断で来院回数は変更可能です


治療中（来院3, 4, 5, 6 ）、治療終了時（来院7）の診査結果の対応については治療ガイドラインの「Checklist」を活用してください

© SheepMedical Co., Ltd.

キレイライン矯正
KIREILIGN ORTHODONTICS

1-27. キレイライン矯正 15回コース+拡大床併用の周期（4.0㎜拡大の場合）

最短の治療期間（アライナー装着期間）：48週（約11ヶ月）

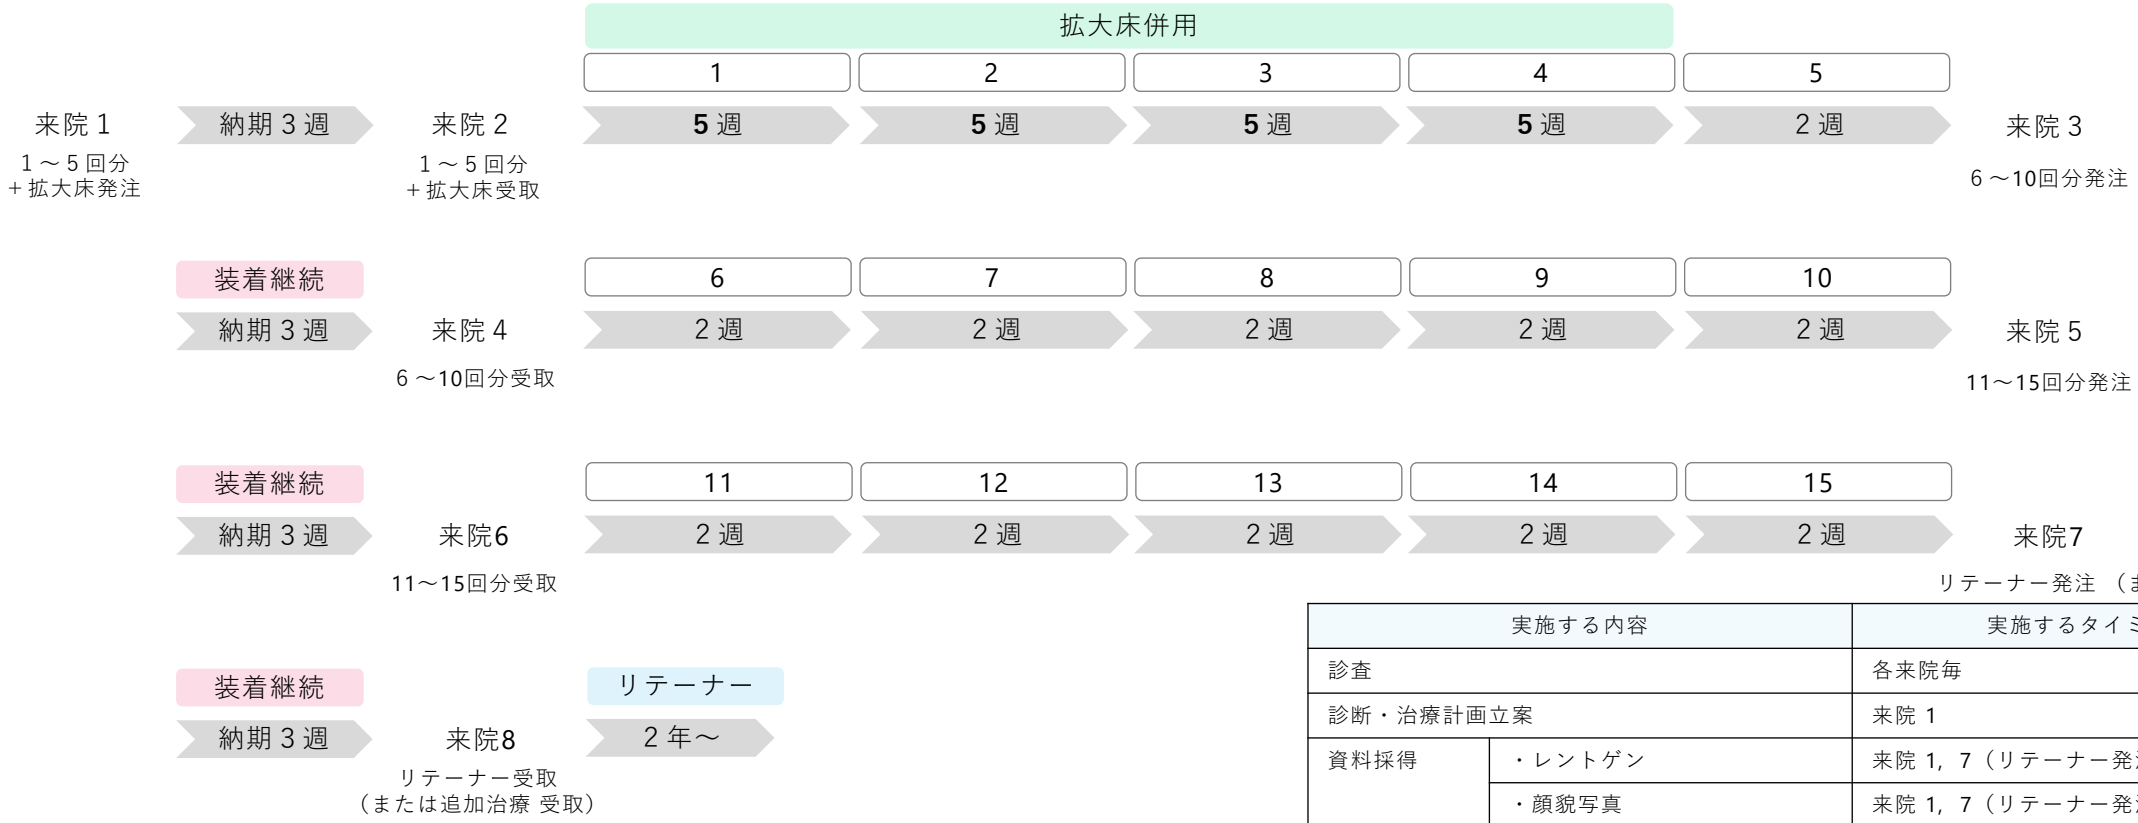

実施する内容		実施するタイミング
診査		各来院毎
診断・治療計画立案		来院 1
資料採得	・レントゲン	来院 1，7（リテーナー発注時のみ）
	・顔貌写真	来院 1，7（リテーナー発注時のみ）
	・口腔内写真	来院 1，7（リテーナー発注時のみ）
	・口腔内スキャン（印象採得）	来院 1，3，5，7

拡大床併用中はクリニック判断で来院回数は変更可能です


治療中（来院3, 4, 5, 6 ）、治療終了時（来院7）の診査結果の対応については治療ガイドラインの「Checklist」を活用してください

© SheepMedical Co., Ltd.

キレイライン矯正
KIREILIGN ORTHODONTICS

1-28. キレイライン矯正 15回コース+拡大床併用の周期（5.0㎜拡大の場合）

最短の治療期間（アライナー装着期間）：51週（約12ヶ月）

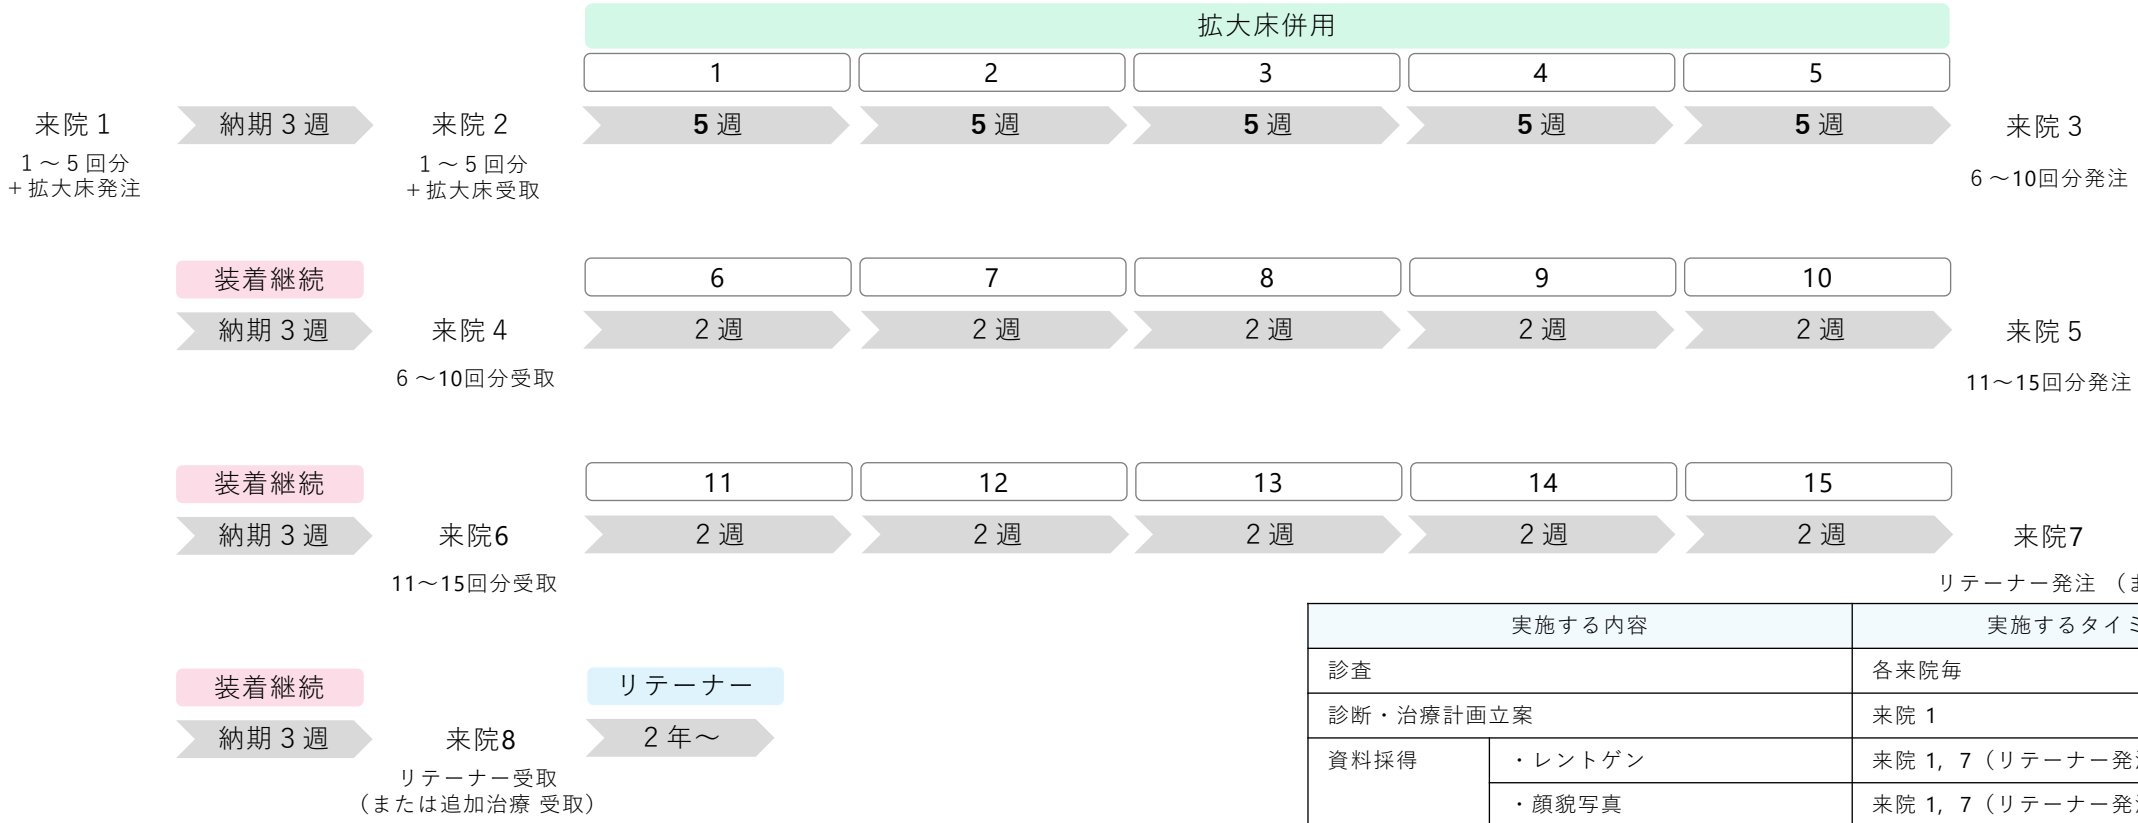

実施する内容		実施するタイミング
診査		各来院毎
診断・治療計画立案		来院 1
資料採得	・レントゲン	来院 1，7（リテーナー発注時のみ）
	・顔貌写真	来院 1，7（リテーナー発注時のみ）
	・口腔内写真	来院 1，7（リテーナー発注時のみ）
	・口腔内スキャン（印象採得）	来院 1，3，5，7

拡大床併用中はクリニック判断で来院回数は変更可能です


治療中（来院3, 4, 5, 6 ）、治療終了時（来院7）の診査結果の対応については治療ガイドラインの「Checklist」を活用してください

© SheepMedical Co., Ltd.

キレイライン矯正
KIREILIGN ORTHODONTICS

1-29. キレイライン矯正 10回コースの周期（分割納品）

最短の治療期間（アライナー装着期間）：23週（約5.5ヶ月）

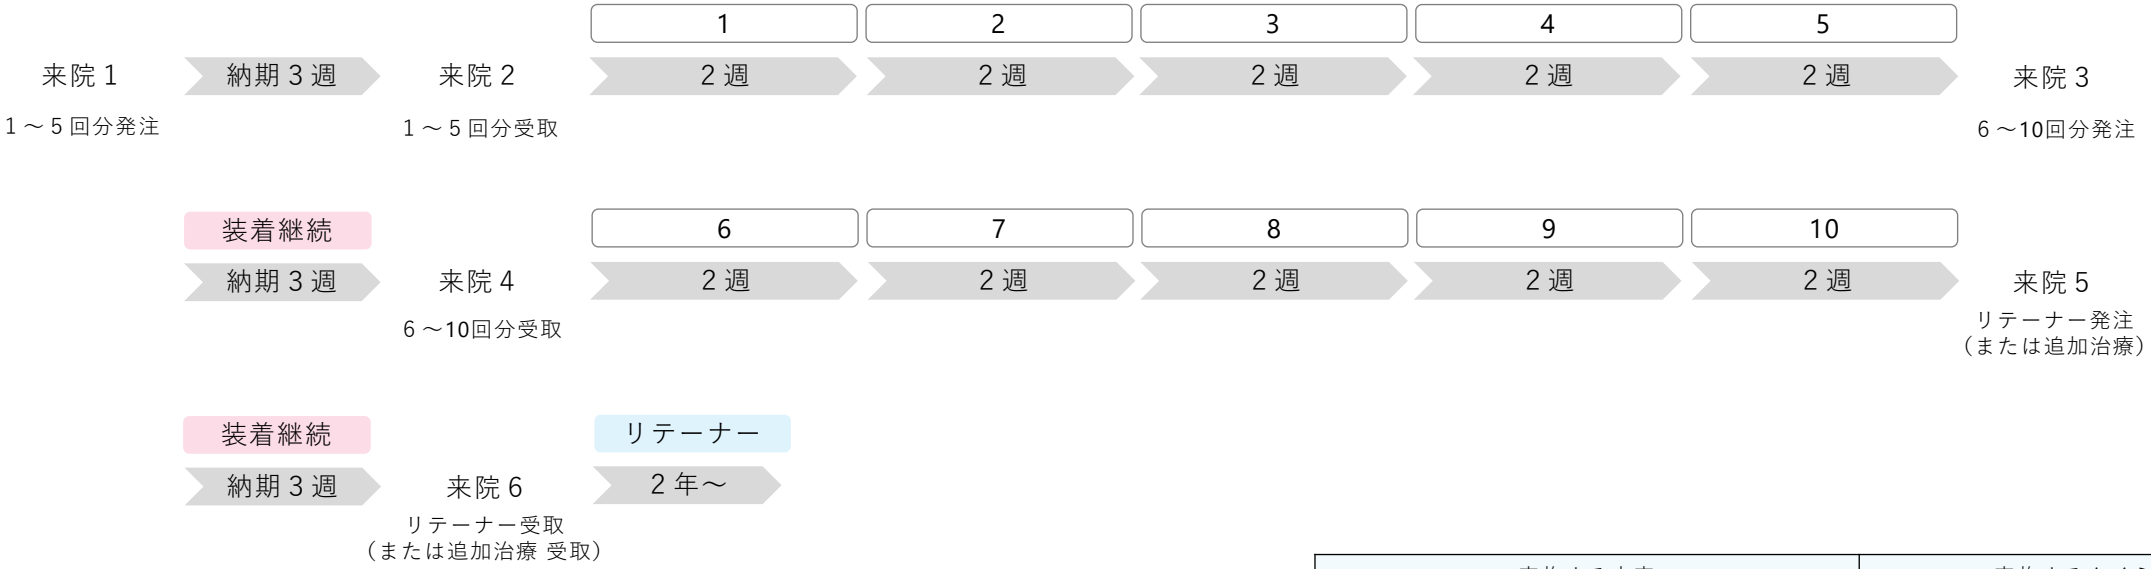

実施する内容		実施するタイミング
診査		各来院毎
診断・治療計画立案		来院 1
資料採得	・レントゲン	来院 1，5（リテーナー発注時のみ）
	・顔貌写真	来院 1，5（リテーナー発注時のみ）
	・口腔内写真	来院 1，5（リテーナー発注時のみ）
	・口腔内スキャン（印象採得）	来院 1，3，5

治療中（来院3, 4 ）、治療終了時（来院5）の診査結果の対応については治療ガイドラインの「Checklist」を活用してください

© SheepMedical Co., Ltd.

キレイライン矯正
KIREILIGN ORTHODONTICS

1-30. キレイライン矯正 15回コースの周期（分割納品）

最短の治療期間（アライナー装着期間）：36週（約8.5ヶ月）



実施する内容		実施するタイミング
診査		各来院毎
診断・治療計画立案		来院 1
資料採得	・レントゲン	来院 1，7（リテーナー発注時のみ）
	・顔貌写真	来院 1，7（リテーナー発注時のみ）
	・口腔内写真	来院 1，7（リテーナー発注時のみ）
	・口腔内スキャン（印象採得）	来院 1，3，5，7

治療中（来院3, 4, 5, 6 ）、治療終了時（来院7）の診査結果の対応については治療ガイドラインの「Checklist」を活用してください

© SheepMedical Co., Ltd.

キレイライン矯正
KIREILIGN ORTHODONTICS

1-31. キレイラインフル 40回コースの周期

最短の治療期間（アライナー装着期間）：92週（約21.4ヶ月）

来院１
１～10回分発注

納期4週

来院２
１～10回分受取

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2 週	2 週	2 週	2 週	2 週	2 週	2 週	2 週	2 週	2 週

来院３
11～20回分発注

装着継続
納期4週

来院４
11～20回分受取

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2 週	2 週	2 週	2 週	2 週	2 週	2 週	2 週	2 週	2 週

来院５
21～30回分発注

装着継続
納期4週

来院６
21～30回分受取

21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
2 週	2 週	2 週	2 週	2 週	2 週	2 週	2 週	2 週	2 週

来院7
31～40回分発注

装着継続
納期4週

来院８
31～40回分受取

31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
2 週	2 週	2 週	2 週	2 週	2 週	2 週	2 週	2 週	2 週

来院９
リテーナー発注
（または追加治療）

装着継続
納期4週

来院１０
リテーナー受取
（または追加治療 受取）

リテーナー
２年～

実施する内容		実施するタイミング
診査		各来院毎
診断・治療計画立案		来院 1
資料採得	・レントゲン	来院 1，9（リテーナー発注時のみ）
	・顔貌写真	来院 1，9（リテーナー発注時のみ）
	・口腔内写真	来院 1，9（リテーナー発注時のみ）
	・CBCT、セファロ	来院 1，9（リテーナー発注時のみ）
	・口腔内スキャン（印象採得）	来院 1，3，5，7，9


治療中（来院3～8 ）、治療終了時（来院9）の診査結果の対応については治療ガイドラインの「Checklist」を活用してください

© SheepMedical Co., Ltd.

キレイライン矯正
KIREILIGN ORTHODONTICS

1-32. アライナーの納品形態



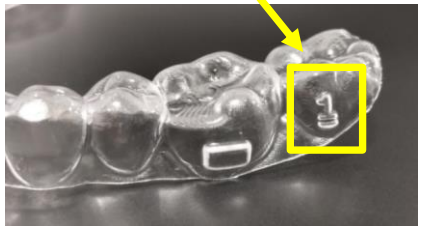

（例）キレイライン矯正１０回コース（一括納品）の場合、１０回分が一括納品される。

回数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ソフト	1/10	2/10	3/10	4/10	5/10	6/10	7/10	8/10	9/10	10/10

（例）キレイライン矯正 １０回コース （分割納品）の場合、および
キレイライン矯正 １０ 回コース（拡大床併用）の場合、２回に分けて納品される。

回数	1	2	3	4	5
ソフト	1/5	2/5	3/5	4/5	5/5

1回目の納品

6	7	8	9	10
1/5	2/5	3/5	4/5	5/5

２回目の納品

全てのアライナーは、矯正治療が終了するまで保管ください

納品時に必ず梱包物のご確認をお願いします。万が一、商品の不足があれば納品翌日までに laboratory@sheepmedical.com 又は 03-6281-0231（事務直通）にご連絡ください。

© SheepMedical Co., Ltd.

キレイライン矯正
KIREILIGN ORTHODONTICS

1-33. 口腔内スキャンデータ/石膏模型が必要なタイミング

		回数														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
キレイライン矯正（一括発注）		○														
キレイライン矯正（分割発注） ※ 拡大床併用含む	5回	○														
	10回	○					○									
	15回	○					○					○				
		5連続セットアップ					5連続セットアップ					5連続セットアップ				

		1	2〜10	11	12〜20	21	22〜30	31	32〜40
キレイラインフル	40回	○		○		○		○	
		10連続セットアップ		10連続セットアップ		10連続セットアップ		10連続セットアップ	

【キレイライン矯正（一括発注）】	一括発注は初回スキャンデータでご契約回数分すべてを製作します
【キレイライン矯正（分割発注）】	分割発注は一度のスキャンデータで5回分を製作します 発注毎に最新スキャンデータが必要です
【キレイラインフル】	一度のスキャンデータで10回分を製作します 発注毎に最新スキャンデータが必要です

© SheepMedical Co., Ltd.

キレイライン矯正
KIREILIGN ORTHODONTICS

1-34. 各商品の発注書・必要資料・納品物 ①

商品	発注書 兼 技工指示書	必要資料	納品物
トライアルマウスピース	初診	スキャンデータ/石膏模型	トライアルマウスピース
契約前シミュレーション		パントモ 顔貌、口腔内写真 スキャンデータ/石膏模型 ※キレイラインフルは上記に ＋CBCT、セファロ	３Dシミュレーションと シミュレーション詳細PDF（メール納品）
キレイライン矯正 1回, 5/10/15回コース（一括発注）			発注分のアライナーと３Dシミュレーション
キレイライン矯正 10/15回コース（分割発注）、 キレイラインフル40回コース※			発注分のアライナーと３Dシミュレーション
キレイライン矯正（分割発注） 6回目以降、 キレイラインフル40回コース11回目以降、 キレイラインフル追加10回	再診	スキャンデータ/石膏模型	発注分のアライナーと３Dシミュレーション └6～10回, 11～15回 └11～20回, 21～30回, 31～40回
追加シミュレーション			３Dシミュレーションとシミュレーション詳細PDF（メール納品）
追加のキレイライン矯正 1回, 5/10/15回（一括発注）			発注分のアライナーと３Dシミュレーション
追加のキレイライン矯正 10/15回コース（分割発注）			発注分のアライナーと３Dシミュレーション
追加のキレイライン矯正（分割発注） 6回目以降			発注分のアライナーと３Dシミュレーション └6～10回, 11～15回

トライアルマウスピースまたは契約前シミュレーション発注後にアライナーを発注する場合の発注書 兼 技工指示書は【初診】です。

必要資料がスキャンのみの場合でも動きが悪い場合は各種資料採得の依頼をする場合があります。

© SheepMedical Co., Ltd.

1-35. 各商品の発注書・必要資料・納品物 ②

商品	発注書 兼 技工指示書	必要資料	納品物
拡大床/バイトプレーン付拡大床	初診	なし（アライナー発注用の初診口腔内データを使用）	拡大床/バイトプレーン付拡大床
クリアリテーナー	再診	パントモ 顔貌・口腔内写真 スキャンデータ/石膏模型＊1	クリアリテーナー
fix（ワイヤー）リテーナー		パントモ 顔貌・口腔内写真 石膏模型	fix（ワイヤー）リテーナー
【再製作】アライナー		なし（製作時の口腔内データを使用＊2）	アライナー
【再製作】リテーナー			リテーナー
【再製作】アタッチメントテンプレート			アタッチメントテンプレート
キレイラインKIDS	初診	パントモ 顔貌・口腔内写真 スキャンデータ/石膏模型	装置 樹脂模型（スキャンデータの場合） ケース
キレイラインKIDS 追加（2個目以降）	再診	口腔内写真 スキャンデータ/石膏模型	装置 樹脂模型（スキャンデータの場合）

＊1　必ず最新スキャンデータ（石膏模型）の提出は必要です。
通常、リテーナーは最終ステージのセットアップデータで製作しますが、もし最新スキャンデータ（石膏模型）を使用する必要がある場合は技工指示書の「最新の口腔内データを使用する」のチェックボックスにチェックをお願いします。
＊2　最新スキャンデータ（石膏模型）を使用する必要がある場合（補綴等で歯の形態が変わった場合など）は、技工指示書の「最新の口腔内データを使用する」のチェックボックスにチェックをお願いします。

© SheepMedical Co., Ltd.

1-36. 納期

商品	納期
契約前シミュレーション	1 週間 *
追加シミュレーション	
トライアルマウスピース	2 週間 *
キレイラインKIDS	
キレイライン矯正 1回, 5/10/15回コース（一括発注 / 分割発注）	3 週間 *
追加のキレイライン矯正 1回, 5/10/15回コース（一括発注 / 分割発注）	
拡大床 / バイトプレーン付拡大床 / クリアリテーナー / fix（ワイヤー）リテーナー	
【再製作】アライナー、リテーナー、アタッチメントテンプレート	
キレイラインフル 40回コース（セットアップ承認制利用必須）	最短 4 週間 *

＊ゴールデンウィーク・お盆・年末年始の時期は通常の納期にプラス1週間必要です。

【セットアップ承認を利用した場合の納期について】

発注日から 1 週間以内にセットアップデータがメールで納品されます。その後、セットアップデータ承認日から 2 週間後にアライナーを発送いたします。ただし、アライナー納期は最短でも発注日から 3 週間（キレイラインフルは4週間）となりますことあらかじめご了承願います。（もし「発注日から 3 週間納期での発送」より「承認日から 2 週間後」のほうが早い日付となる場合、発送は前倒しせず発注日から 3 週間納期（キレイラインフルは4週間納期）のままでのアライナー発送とさせていただきます）

© SheepMedical Co., Ltd.

キレイライン矯正
KIREILIGN ORTHODONTICS

1-37. 発注書 兼 技工指示書の記入例

発注書 兼 技工指示書　記入例

アライナーと拡大床は1枚の指示書で発注できません。

拡大床併用の場合、アライナー発注の『初診 発注書 兼 技工指示書』と拡大床発注の『初診 発注書 兼 技工指示書』のアップロードが必要です。

【初診 発注書 兼 技工指示書】拡大床併用のアライナー発注



【初診 発注書 兼 技工指示書】拡大床発注



発注書 兼 技工指示書はキレカルからダウンロードします

© SheepMedical Co., Ltd.

1-38. 解約（分割発注の場合のみ対象）

契約内容	パターン		返金額	差引額	備考
キレイライン矯正 10回	5回で中断	5まで発注済	¥110,000	¥220,000	10回-5回分：330,000-(44,000×5)
キレイライン矯正 15回	5回で中断	5まで発注済	¥242,000	¥220,000	15回-5回分：462,000-(44,000×5)
	10回で中断	10まで発注済	¥22,000	¥440,000	15回-10回分：462,000-(44,000×10)

価格はすべて税込みです

発注済分のキャンセルはできかねます

患者様への返金は解約に伴う手数料（各クリニック様設定）を差引いてご返金ください

キレイラインフルは解約の対象ではありません

© SheepMedical Co., Ltd.

1-39. 送患料（広告システム利用料）

対　　象	HPから予約した患者様が来院した場合
送　患　料	¥38,500*/人 （税込み）
請　求　額	月間の送患者数×¥38,500*
請求書発行	翌月5営業日にメールにて発行

＊委託料は契約・発注の実績値により変動いたします（変動する場合は事前に弊社よりお知らせいたします）

請求書のご不明点についてはセールス担当までご連絡またはメールにてお問合せください　sales@sheepmedical.com

© SheepMedical Co., Ltd.

1-40. 転院

対　　象	同一法人内
条　　件	・転院による解約および手続き等に関する手数料が発生しない ・転院先クリニックで患者様が希望している治療が可能 ・転院元クリニックと患者様でトラブルがない ・転院元クリニックで商品の受取りが完了している ・未払い金がない

転院元　クリニック	転院先　クリニック
1．転院先へ受入確認の連絡	受入可否検討
2．契約状況の確認	
3．転院先へ以下のデータを送信 ・同意書データ　・カルテデータ　・レントゲン写真データ　・口腔内写真データ	データを受け取った後、キレカルで患者様を新規登録してIDを発行する。 患者備考欄に「〇〇クリニックからの転院」と入力する
4．転院先へデータ移行が完了（1週間～）した時点で、患者様に転院手続き完了の連絡をする	
5．患者様が転院先へ連絡し予約を取る	

転院のご不明点についてはセールス担当までご連絡またはメールにてお問合せください　sales@sheepmedical.com

© SheepMedical Co., Ltd.

キレイライン矯正
KIREILIGN ORTHODONTICS

1-41. キレイラインKIDS　初回来院時と装置受取り時の対応

スケジュール（約60分）

流れと目安時間

	資料採得 (約20分)	診査診断 (約10分)	カウンセリング・契約 (約30分)
初回来院	• 口腔内3Dスキャンまたは印象・咬合採得 • パントモ • 写真撮影 ➢ 顔貌写真（3枚） ➢ 口腔内写真（5枚）	通常の矯正治療の診断に準ずる • キレイラインKIDS対象かの見極め • 装置の選択 （Tongue Lift Type/Growth Type）	• 装置の説明 • 治療期間・金額の説明 契約 • 同意書記入

	装置のご説明 (約60分)
装置受取来院	装置のお渡し 「キレイラインKIDSお渡し資料」にて次の内容を説明する ①装置の付け方、②装置の使い方、③装置の洗い方、④トレーニング方法、⑤記録表の使い方 初回来院時に パントモ、顔貌・口腔内写真撮影ができていない場合は実施

© SheepMedical Co., Ltd.

1-42. キレイラインKIDS　来院スケジュール

治療期間：１年

来院１（60分）
装置発注
→ 納期２週 →
来院２（60分）
装置受取
→ ４～６週 →
来院３（30分）
1回目 診察
→ ３～４か月 →
来院４（30分）
２回目 診察
→ ３～４か月 →
来院５（30分）
３回目 診察
→ ３～４か月 →
来院６（30分）
４回目 最終診察

ご契約日から11か月目までスケジュール通りに診察にお越しいただき、
治療経過の確認をします。

【診察内容】

口腔内診察、装置の変形・破損確認、資料採り、装置の装着方法・装着時間の確認

実施する内容		実施するタイミング
カウンセリング、診査診断		来院 1
資料採得	・口腔内スキャン（印象採得）	来院 1
	・パントモ	来院 1（または 2）
	・顔貌写真	来院 1（または 2）
	・口腔内写真	来院 1（または 2）, 来院3, 4, 5, 6
装置お渡し、装置のご説明		来院 2
診察		来院 3, 4, 5, 6

装置は破損やサイズが合わなくなるまで、ずっとお使いいただけます。

基本的に使いすぎて不具合を生じることはありません。使用する時間や期間が長くなるほど効果を期待できます。但し、年齢とともに効果の出かたは減弱します。

© SheepMedical Co., Ltd.

2. キレカルシステムに関する情報

キレイライン矯正
KIREILIGN ORTHODONTICS

2-1. 初期設定

<table>
<tr>
<td>親機の設定</td>
<td>
① https://kirekar.com/loginにアクセス
② 「スタッフID」を入力※
③ 「パスワード」を入力（kirei12345）
④ 「ログイン」をクリック
パスワードを変更したい場合
⑤ 「パスワード」を入力
</td>
<td>


変更したパスワードは必ずメモ等に記録してください
忘れた場合ログインできなくなります
</td>
</tr>
<tr>
<td>子機の設定</td>
<td>
⑥ https://kirekar.com/loginにアクセス
⑦ 「スタッフID」を入力※
⑧ 「パスワード」を入力（親機と同じ）
⑨ 「ログイン」をクリック
⑩ “未登録のIPアドレスからのアクセスです”と表示されたら親機側で許可
</td>
<td>


親機の⚙から”IPアドレス制限 ” をクリックしリクエストを許可

子機では患者登録削除および診療日変更はできません
</td>
</tr>
</table>

※ 弊社よりメールでお知らせします

初期設定以降にパスワードの変更を要する場合には、セールス担当までご連絡またはメールにてお問合せください sales@sheepmedical.com

© SheepMedical Co., Ltd.

キレイライン矯正
KIREILIGN ORTHODONTICS

2-2. 診療日の設定

① ⚙をクリック

② 「環境設定」をクリック

③ 「予約設定日時」をクリック

営業日設定_設定1

④ 診療曜日にチェック

⑤ “営業時間”に午前の診療時間を設定

⑥ 「+」をクリックし設定2を追加

営業日設定_設定2


⑦ 診療曜日にチェック

⑧ “営業時間”に午後の診療時間を設定

⑨ 入力が完了したら「変更を適用する」をクリック

増設は「+」マークをクリックして追加



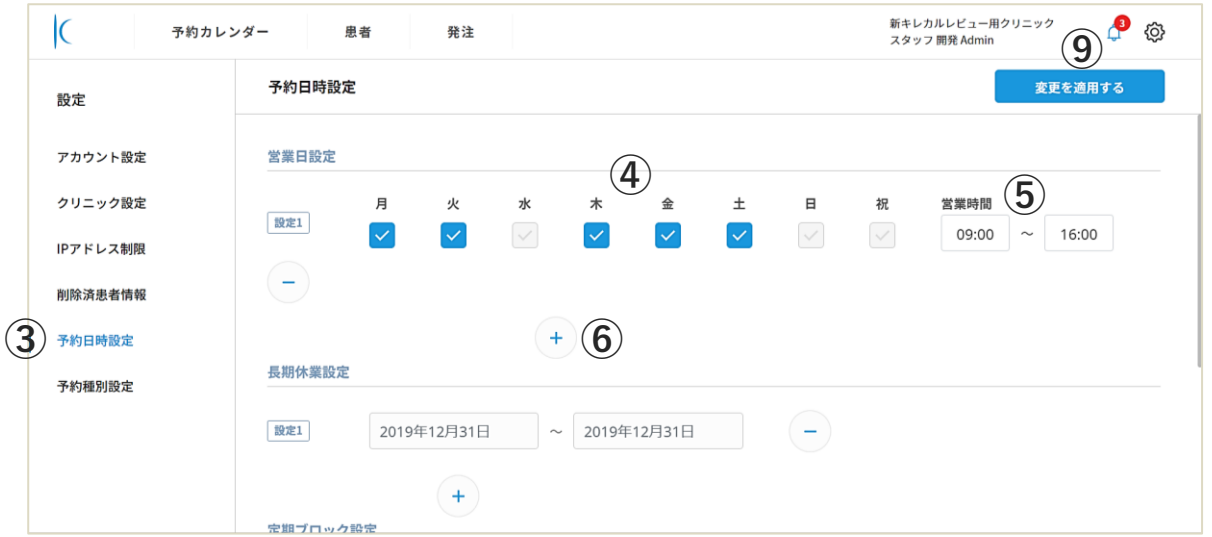

© SheepMedical Co., Ltd.

キレイライン矯正
KIREILIGN ORTHODONTICS

2-3. 特別営業日の設定

① ⚙をクリック

② 「環境設定」をクリック

③ 「予約設定日時」をクリック

特別営業日設定

④ 特別営業日をカレンダー上で選択

⑤ “営業時間”を選択

増設は「+」マークをクリックして追加



休診日（診療日設定でチェックしていない曜日）に特別営業日を設定することで予約可能となります

© SheepMedical Co., Ltd.

キレイライン矯正
KIREILIGN ORTHODONTICS

2-4. 長期休業の設定

① ⚙ をクリック

② 「環境設定」をクリック

③ 「予約日設定」をクリック


長期休業設定_設定1

④ カレンダーから開始日と終了日を設定

⑤ 入力が完了したら「変更を適用する」をクリック

増設は「+」マークをクリックして追加



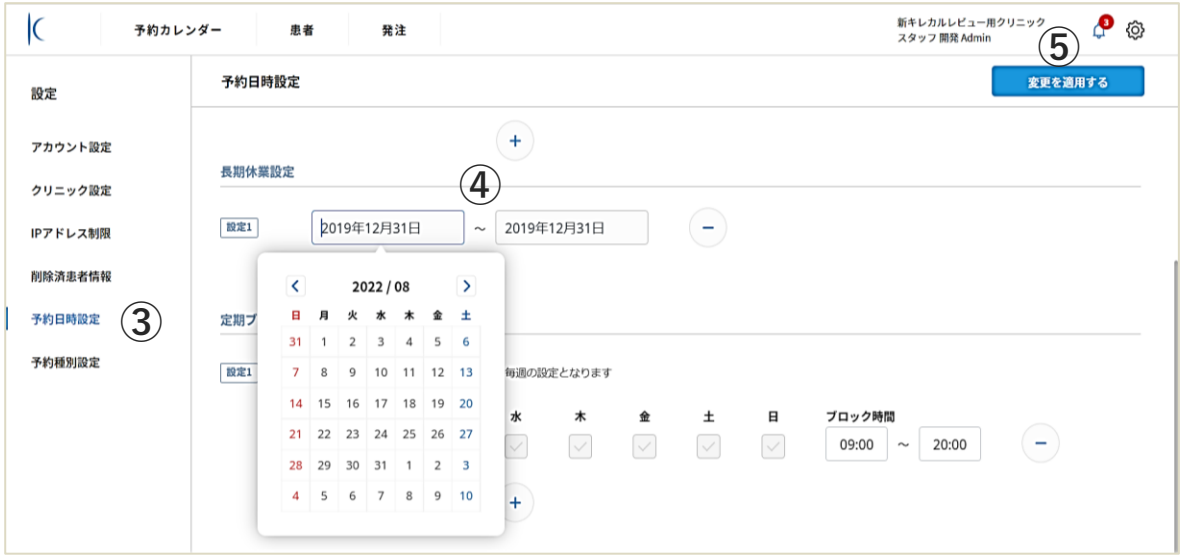

© SheepMedical Co., Ltd.

キレイライン矯正
KIREILIGN ORTHODONTICS

2-5. ブロック枠の設定

① ⚙ をクリック

② 「環境設定」をクリック

③ 「予約日設定」をクリック

定期ブロック設定_設定1

④ 「第XX週」に数字を入力

⑤ ブロックする曜日にチェック

⑥ “ブロック時間”にブロックする時間を設定

⑦ 入力が完了したら「変更を適用する」をクリック

増設は「+」マークをクリックして追加





© SheepMedical Co., Ltd.

キレイライン矯正
KIREILIGN ORTHODONTICS

2-6. 時間帯のブロック設定

ブロックの設定

① 予約カレンダーのブロック時間帯をドラッグ

新規予約画面

② “この枠をブロックする”にチェック

③ 「予約を登録」をクリック


ブロックの解除

④ 解除する枠をクリック

ブロック枠編集画面

⑤ 「ブロック枠解除」をクリック

⑥ ポップアップの「はい」をクリック

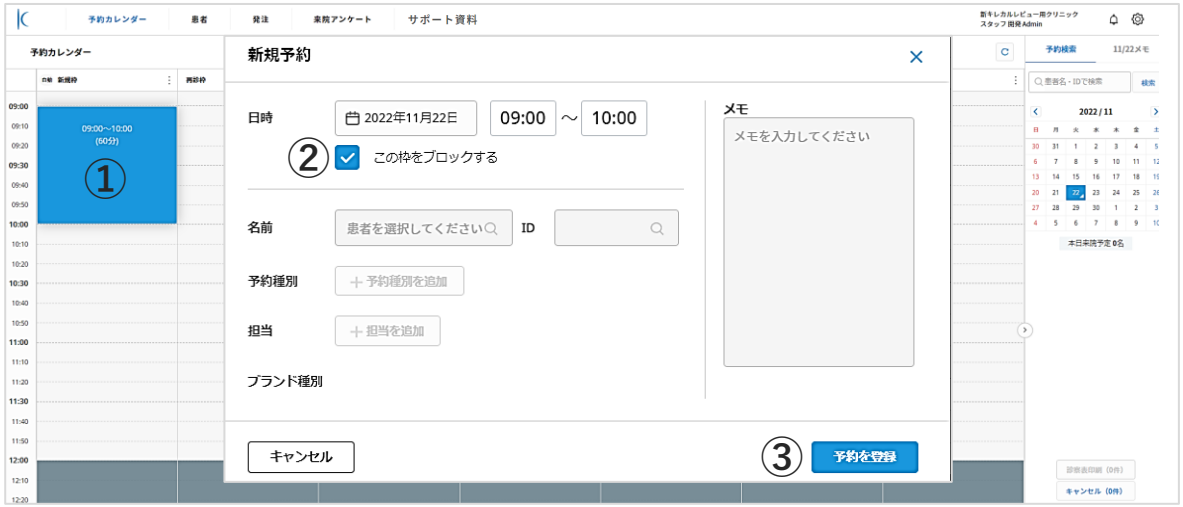



© SheepMedical Co., Ltd.

キレイライン矯正
KIREILIGN ORTHODONTICS

2-7. 初回検診ご予約フォーム画面

“ご希望のエリア”（47都道府県別）を選択すると
キレイライン提携クリニックが表示されます

クリニックは最寄り駅と紐づけ登録しています

所要時間の目安や費用の記載もしています

ご希望の日時選択 必須
初回検診の所要時間は約60分です。
デンタルローンなど諸手続きにお時間を追加で30分程度頂く場合がございます。
クリニックにより診療時間が前後する場合がございます。詳しくはご予約中のクリニックまでお問い合わせください。
予約時間の10分前にはお越しください。
初回検診はご契約の有無にかかわらず、初診料（税込3,500円）が別途かかります。
※検診費用はクリニックによって異なります。
『予約日の前日・当日のキャンセル』『無断キャンセル』のみ、キャンセル料3,300円（税込）が発生いたします。



初回検診ご予約フォーム　https://lp.kireilign.com/yoyaku

© SheepMedical Co., Ltd.

キレイライン矯正
KIREILIGN ORTHODONTICS

2-8. 初回検診ご予約フォームとキレカルの連携

初回検診ご予約フォームのカレンダーはキレカル予約カレンダーの「自動枠」と連動しています。

初回検診ご予約フォームカレンダー


日時	01 (木)	02 (金)	03 (土)	04 (日)	05 (月)
10:00	×	◎	ー	ー	×
10:30	×	◎	ー	ー	×
11:00	ー	×	ー	ー	ー
11:30	◎	×	×	ー	◎
12:00	◎	×	×	◎	◎

予約不可（予約済）
予約が取れない状態です

予約不可（クリニック様都合）
予約が取れない状態です

予約可能

キレカルの予約カレンダー

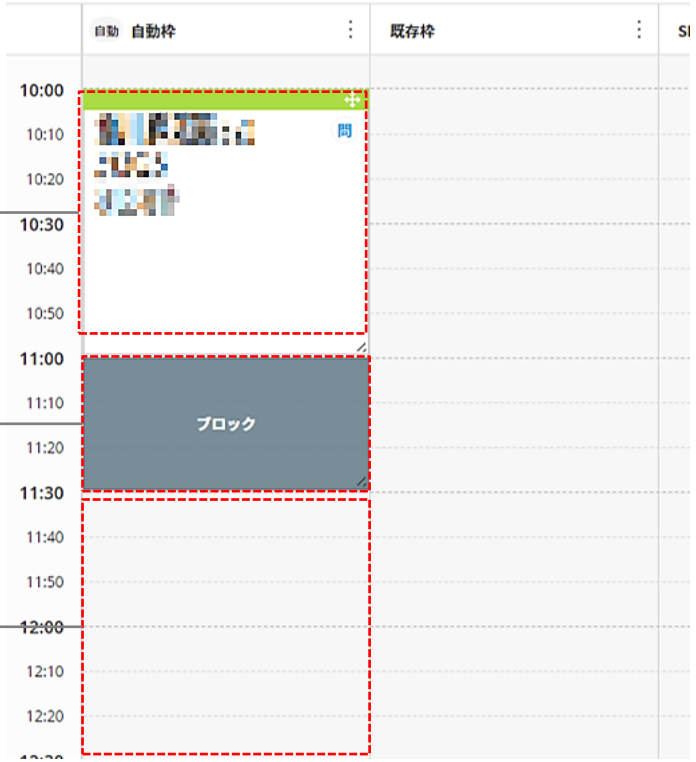

キレカルの予約カレンダーに1時間以上の空きがない場合は初回検診ご予約フォームカレンダーに◎は表示されません

© SheepMedical Co., Ltd.

キレイライン矯正
KIREILIGN ORTHODONTICS

2-9. 患者様からの予約・変更・キャンセル通知

初回検診ご予約フォームから予約および予約に対する変更またはキャンセルはアラート表示されます。

① 🔔 をクリック

通知画面

② 患者名をクリック

患者名を表示：生年月日や性別等が確認できる

予約を表示　：予約カレンダー画面が確認できる

予約・変更・キャンセルのお知らせは、
クリニック様のメールアドレスにも届きます。



© SheepMedical Co., Ltd.

キレイライン矯正
KIREILIGN ORTHODONTICS

2-10. 初回検診ご予約フォーム以外から予約された患者様の登録

① 「患者」をクリック

② 「患者登録」をクリック

基本情報

③ 必須項目を入力

その他備考

④ 初回検診ご予約フォーム以外からの予約と分かるように内容を必ず入力してください
入力がない場合は送患料の対象になります

入力例：クリニック既存患者様の場合
「クリニック既存患者」

⑤ 「保存する」をクリック



必須項目以外の情報は後から編集できます

© SheepMedical Co., Ltd.

キレイライン矯正
KIREILIGN ORTHODONTICS

2-11. 予約登録（初回検診ご予約フォーム以外の予約/再診予約）

① 来院希望日の予約カレンダーを開く

② 来院時間から処置に必要な時間分をドロップ


新規予約画面

③ 名前またはIDを入力し 🔍 をクリック

患者を選択画面

④ 該当患者を選択し「予約を登録」をクリック

⑤ 同一時間帯の「自動枠」に初回検診ご予約フォームからの予約をブロックする場合は設定する

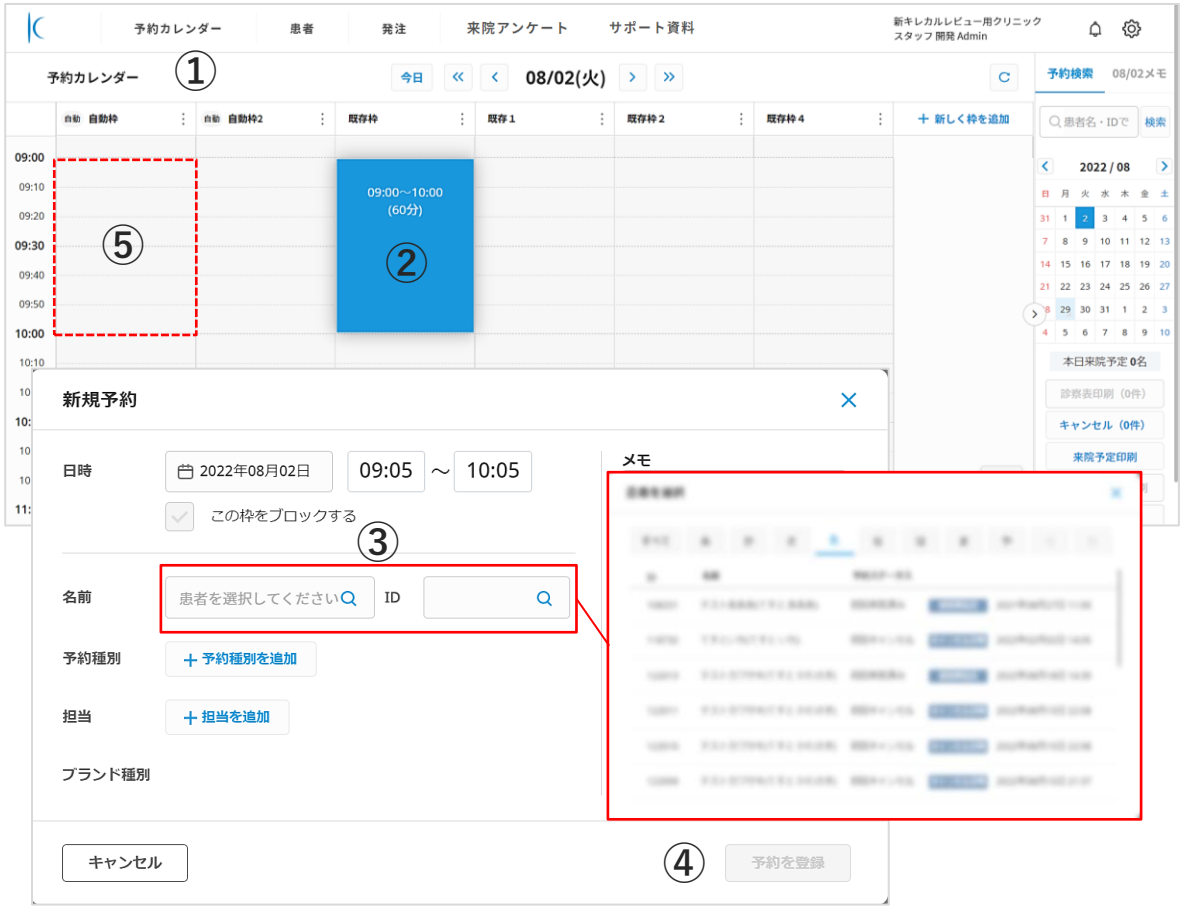

予約がダブルブッキングしないようにブロック設定をしてください

© SheepMedical Co., Ltd.

キレイライン矯正
KIREILIGN ORTHODONTICS

2-12. 予約日/時間の変更 ①

① 変更する枠をクリックする

予約編集画面

日程を変更


② 日付をクリックしカレンダーの希望日をクリック

時間を変更

③ 時間をクリックし設定する

④「予約更新」をクリック

同日の時間変更はクリックしたまま移動可能

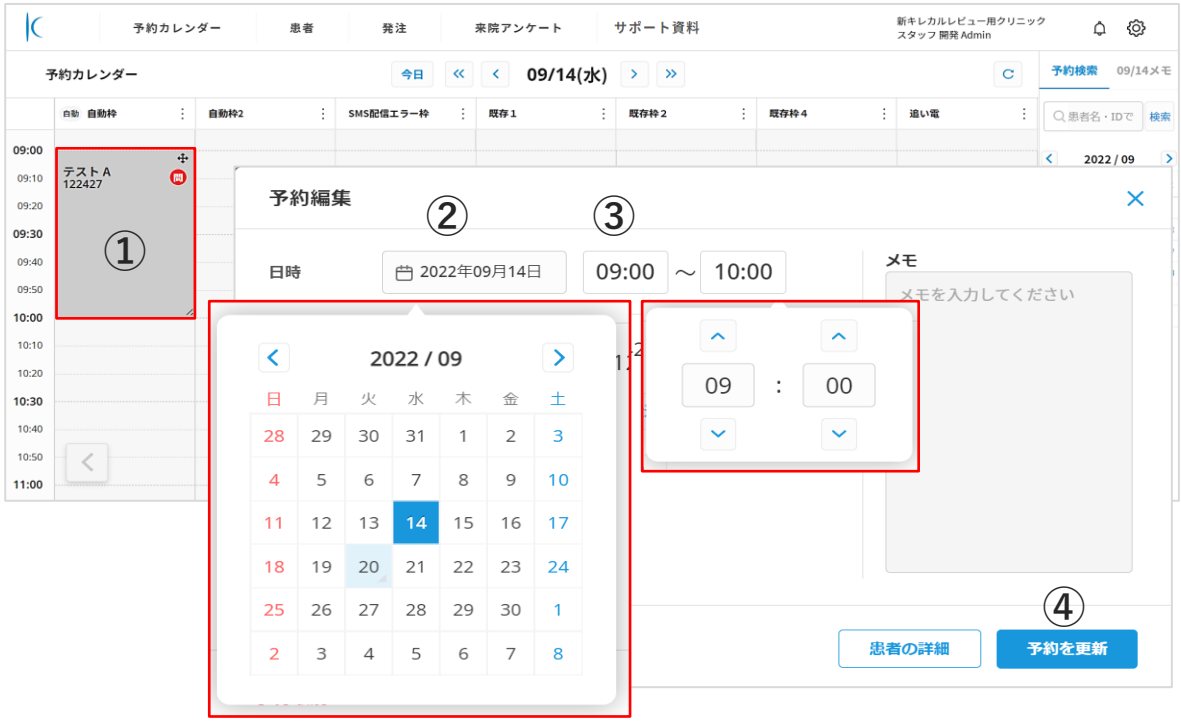

予約がダブルブッキングしないようにブロック設定をしてください

© SheepMedical Co., Ltd.

キレイライン矯正
KIREILIGN ORTHODONTICS

2-13. 予約日/時間の変更 ②


① 変更する枠の右上の✣をクリックする（予約枠が動くようになる）

② 日付の横の矢印をクリックし希望する日に変更する
またはカレンダーで希望する日をクリックし変更する

③ 希望する時間の枠内をクリックする

④ 「予約変更」の表示が出たら「はい」をクリックする

⑤ 希望日時に変更完了

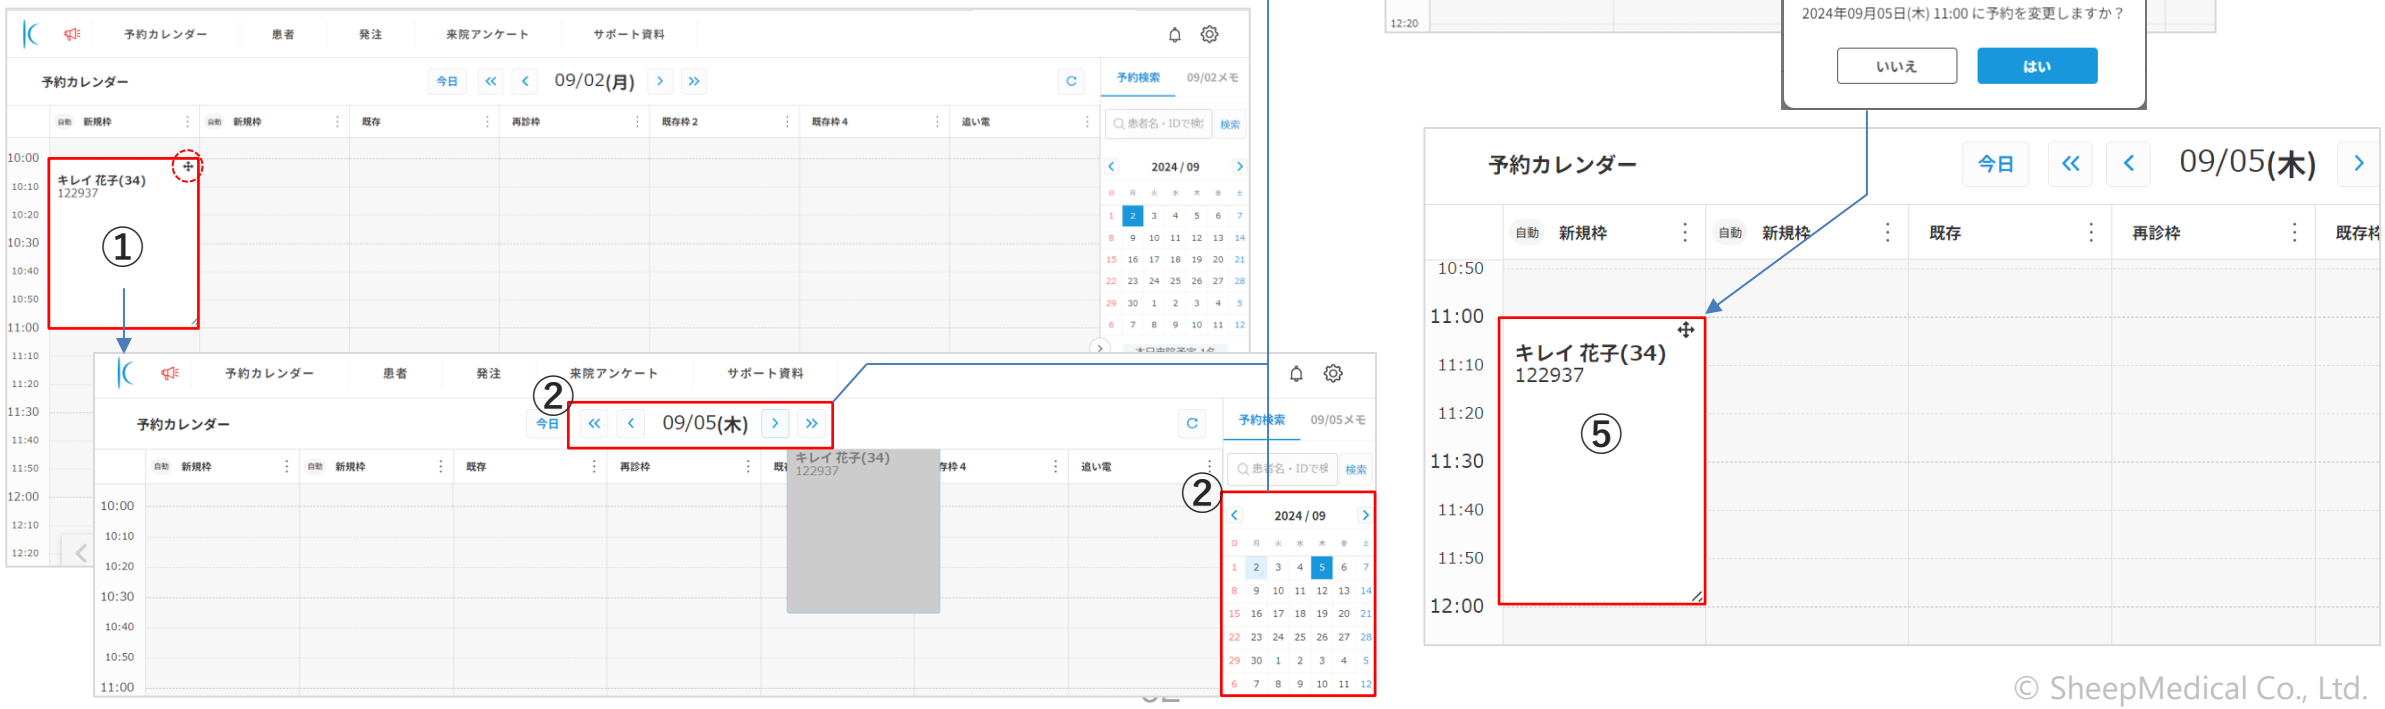

© SheepMedical Co., Ltd.

キレイライン矯正
KIREILIGN ORTHODONTICS

2-14. 予約キャンセル処理

患者様から予約キャンセルの連絡があった場合に、
クリニック様側で次のキャンセル処理を行います。

① キャンセルする患者様の予約枠内をクリック

予約編集画面

② 予約編集画面が開いたら「予約取消」をクリック

③ キャンセル理由を選択し「取り消す」をクリック



キャンセルは当日中に処理してください

初回検診ご予約フォームから予約された患者様で、キャンセル処理されていない場合は、送患料の対象になります。

© SheepMedical Co., Ltd.

2-15. コメント機能（患者情報メモ）

患者情報の「コメント」はクリニック様のメモとして使用できます

① 「患者情報」をクリック

基本情報として次の内容が確認できる

- お名前（漢字、ふりがな）
- 生年月日
- 性別
- 住所
- 電話番号

② コメント欄に入力し「送信」をクリックすると保存される



「送信」をクリックしてもコメントは患者様へ送信されません

© SheepMedical Co., Ltd.

キレイライン矯正
KIREILIGN ORTHODONTICS

2-16. アクティビティ

予約の受付や問診票の作成等、対応者や作成者およびが操作日時を表示しています



© SheepMedical Co., Ltd.

キレイライン矯正
KIREILIGN ORTHODONTICS

2-17. 問診票入力案内の送信

① 該当枠をクリック（問：未入力 問：入力済）

予約編集画面

② 「患者の詳細」をクリック

患者画面

③ 「問診票」横の表示「未入力」をクリック

事前問診票案内SMS送信画面

④ 「SMSを送信する」をクリック



来院時に事前問診票が未入力の場合もSMSを送信して入力いただけます

© SheepMedical Co., Ltd.

2-18. 未契約理由の入力方法

未契約理由の入力方法は2パターンあります
次のどちらかの方法で入力してください

① 予約カレンダーから入力する方法（2-19 参照）
② 患者情報から入力する方法（2-20 参照）

© SheepMedical Co., Ltd.

キレイライン矯正
KIREILIGN ORTHODONTICS

2-19. 未契約理由の入力方法 ①

① 予約カレンダーの患者様枠をクリック
② 「選択」をクリック
③ 該当する理由を選択し、「決定」をクリック
④ 「予約を更新」をクリック
⑤ 予約内容を変更しました のポップアップが表示される









未契約の場合、サポートセンターから患者様へフォロー電話をする可能性があります。

© SheepMedical Co., Ltd.

キレイライン矯正
KIREILIGN ORTHODONTICS

2-20. 未契約理由の入力方法 ②

① 患者情報の中の「編集」をクリック
② 「選択」をクリック
③ 該当する理由を選択し、「決定」をクリック
④ 「保存する」をクリック
⑤ 選択した理由が表示される









未契約の場合、サポートセンターから患者様へフォロー電話をする可能性があります。


© SheepMedical Co., Ltd.


キレイライン矯正
KIREILIGN ORTHODONTICS

2-21. 来院予定表の印刷

① 「来院印刷予定」をクリック

PCのダウンロードフォルダにダウンロードされます
PDFデータから印刷します

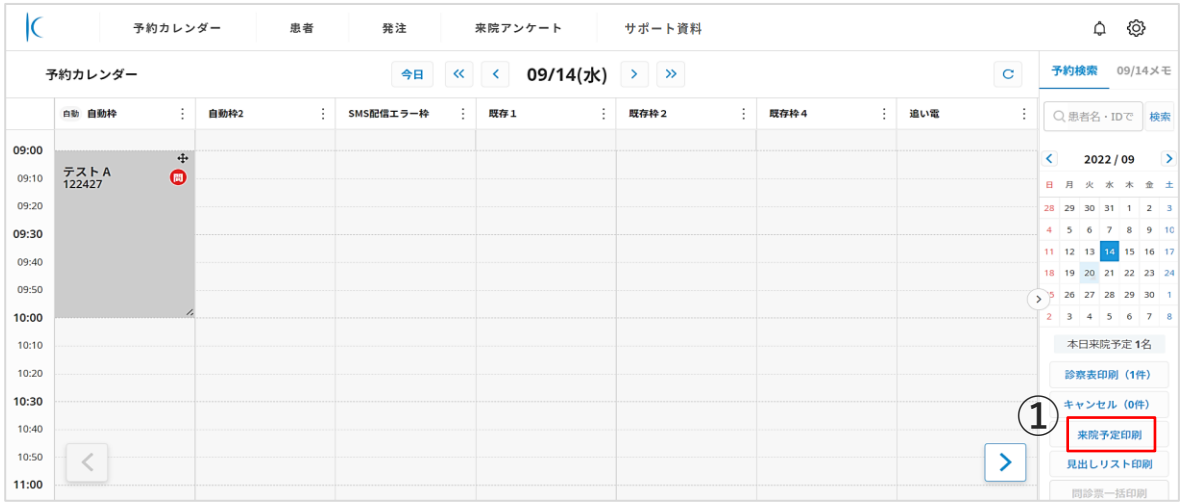

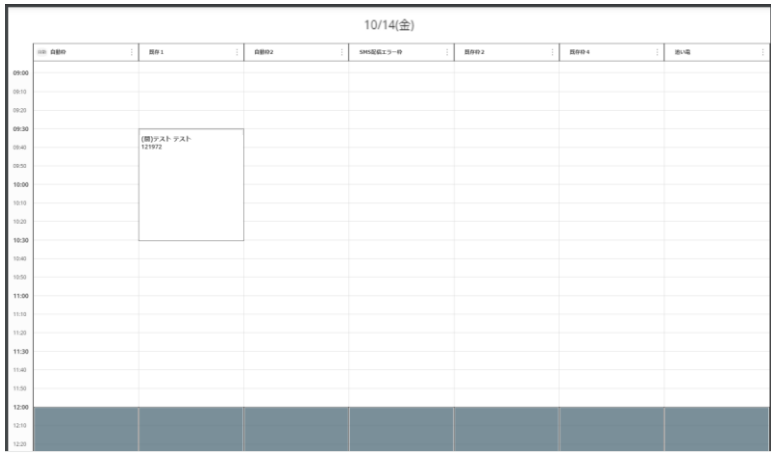

印刷イメージ

© SheepMedical Co., Ltd.

キレイライン矯正
KIREILIGN ORTHODONTICS

2-22. 技工指示書の印刷 ①

① 印刷する該当日の「技工指示書印刷」をクリック

本日来院予定者の技工指示書テンプレートを印刷画面

② 該当患者にチェックを入力

③ 「チェックした X 件のテンプレートを印刷」をクリック

PCのダウンロードフォルダにダウンロードされます
PDFデータから印刷します



© SheepMedical Co., Ltd.

キレイライン矯正
KIREILIGN ORTHODONTICS

2-23. 技工指示書の印刷 ②

① 該当枠内の患者名をクリック


患者情報画面

② 「患者の技工発注」をクリック

患者_技工発注画面

③ 「初診表テンプレート」または「再診表テンプレート」をクリック

表示された印刷画面から印刷

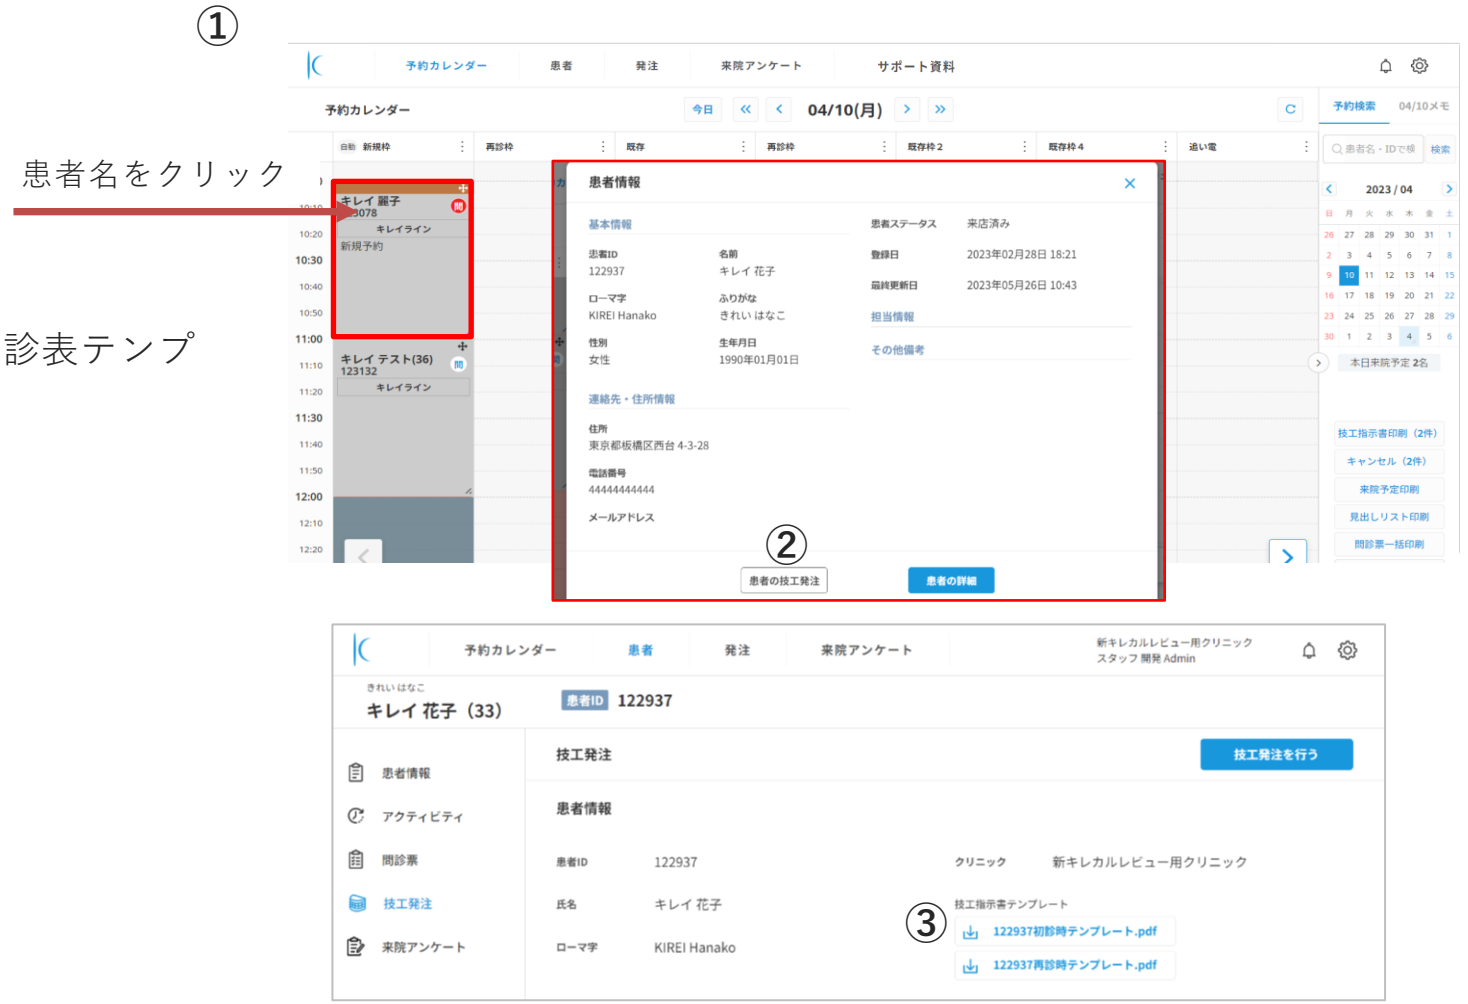

© SheepMedical Co., Ltd.

キレイライン矯正
KIREILIGN ORTHODONTICS

2-24. 発注の流れ（技工指示書、写真、レントゲン、口腔内スキャンのアップロード）

① 該当患者の「技工発注」をクリック

② 「技工発注を行う」をクリック

発注画面

③ 今回の注文数の選択肢を設定

1ステージ	9ステージ （【旧】追加一括）
3ステージ （【旧】）	10ステージ
5ステージ	15ステージ
6ステージ （【旧】追加一括）	キレイラインKIDS
	その他

④ 技工指示書のアップロード


⑤ 顔貌写真・口腔内写真・レントゲンのアップロード

⑥ 口腔内スキャンのアップロード

次の場合は口腔内スキャンのアップロード不要

・技工所へ口腔内の印象採得を石膏模型で提出する場合
・技工所へSTLデータをiTeroエレメント®で送信する場合

⑦ 「発注確認」をクリックする

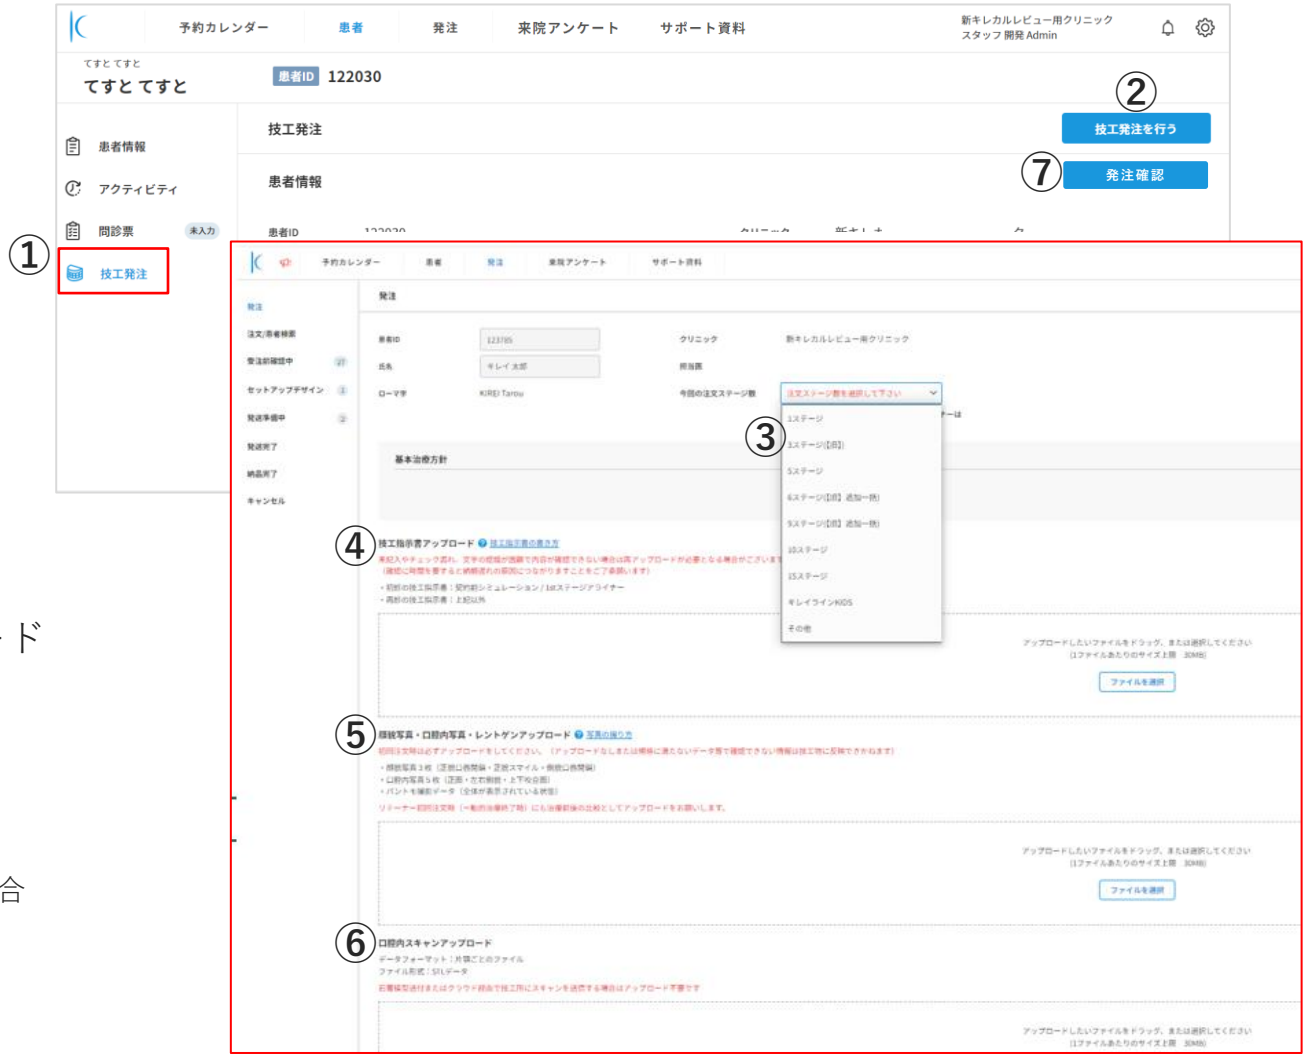

顔貌写真・口腔内写真・レントゲンは契約前シミュレーション含む初回発注と治療終了（リテーナー発注）時に必要です

© SheepMedical Co., Ltd.

キレイライン矯正
KIREILIGN ORTHODONTICS


2-25. 発注の流れ（スキャンデータ/石膏模型の送付）

スキャンデータの場合　（２種類の方法があります）	石膏模型の場合
① 口腔内スキャン（STLデータ）をiTeroエレメント®で送信 （iTeroを使用した場合のみ可能） ② 口腔内スキャン（STLデータ）をキレカルにアップロード	石膏模型を技工所に郵送 **〒175 - 0045　東京都板橋区西台4-3-28** **SheepMedical株式会社（板橋技工所）** **TEL：03-6281-0231** 「石膏模型」に次の情報を記載してください ・　患者ID（キレカルに表示されているID番号） ・　患者名 ・　印象採得日 石膏模型の送料は発払い（クリニック様負担）です

© SheepMedical Co., Ltd.

2-26. iTero®でのスキャンデータ送信方法

iTeroでのスキャンデータ送信方法は2パターンあります
次のどちらかの方法を選択してください

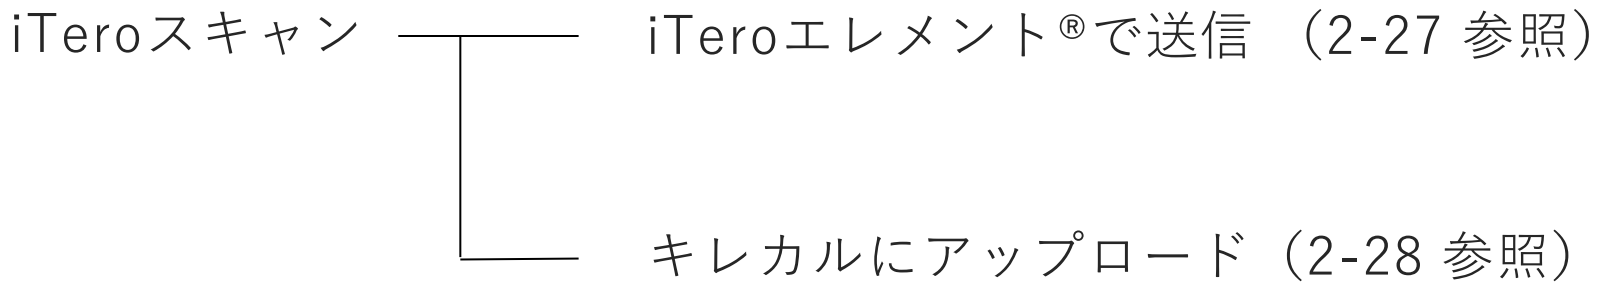

© SheepMedical Co., Ltd.

2-27. iTeroエレメント®による資料採得

iTero本体から専用サーバー経由でのスキャンデータ送信が可能です

iTeroエレメント®を導入されている場合は以下の設定でスキャンしてください

【 Fixed Restorative使用する際は事前に送信先登録が必要】

アライン テクノロジー ジャパン社へ「SheepMedical株式会社」の登録を依頼する

【スキャンの手順】

1. 新規にスキャンする際、「治療項目」のプルダウンの中から「Fixed Restorative」を選択する
2. 「送信先」のプルダウンの中から「SheepMedical Co., Ltd.」を選択する
3. 上顎、下顎のスキャンをおこなう
4. バイトスキャンをおこなう
5. 画面の最上段の「メールマーク」をタップしスキャンデータを送信する

SheepMedicalへのスキャンデータ送信方法を変更する場合は、laboratory@sheepmedical.com へご一報ください。

Fixed Restorativeでスキャンした際はインビザライン・アウトカムシミュレーターとタイムラプスは使用不可となります

© SheepMedical Co., Ltd.

2-28. iTero®スキャンデータの出力とキレカルへのアップロード方法

1. MY iTeroにログイン（https://bff.cloud.myitero.com/login）
2. 患者検索/選択をし「エクスポート」をクリック
   - エクスポートタイプ：「オープンシェル」
   - データフォーマット：「片顎ごとのファイル（咬合状態に配向された歯列弓）」
   - ファイル形式　　：「STL（白黒）」

   上記を選択し「エクスポート」をクリック
3. エクスポートしたZIPファイルの中で 次の2つのSTLデータのみをキレカルにアップロードする
   - 上顎のSTLデータ：123456789（iTero ID）_shell_occlusion_u
   - 下顎のSTLデータ：123456789（iTero ID）_shell_occlusion_l

SheepMedicalへのスキャンデータ送信方法を変更する場合は、laboratory@sheepmedical.com へご一報ください。

© SheepMedical Co., Ltd.

キレイライン矯正
KIREILIGN ORTHODONTICS

2-29. 発注状況の確認

発注画面

発注ステータス

① 受注前確認中：技工所確認中

② セットアップデザイン：製作中

③ 発送準備中　：製作完了、発送準備

④ 発送完了　　：技工所発送からクリニック納品まで

⑤ 納品完了　　：納品物検収済



© SheepMedical Co., Ltd.

キレイライン矯正
KIREILIGN ORTHODONTICS

2-30. 納品物の検収

納品された技工物の内容に不備がないか検収し、クリニック様側で「発送完了」から「納品完了」へステータスの変更を行います。

ステータスの変更方法

① 「発送完了」をクリック

② 検収済の発注情報にチェック

③ 「チェックした注文を納品完了にする」をクリック

④ 「はい」をクリック

⑤ 「納品完了」をクリックし表示を確認



納品完了のステータスは、クリニック様側で上記①～④をおこなった場合のみ表示されます。

納品時に必ず梱包物のご確認をお願いします。万が一、商品の不足があれば納品翌日までに laboratory@sheepmedical.com 又は 03-6281-0231（事務直通）にご連絡ください。

キレイライン矯正
KIREILIGN ORTHODONTICS

2-31. 納品物の検収 （誤って「納品完了」にステータス変更した場合の対応方法）

誤って「納品完了」へステータスの変更を行ってしまった場合の対応方法。





「発送完了」に戻す方法

① 「納品完了」をクリック

② 該当する発注情報にチェック

③ 「チェックした注文を発送完了に戻す」をクリック

④ 「はい」をクリック

⑤ 「発送完了」をクリックし表示を確認

キレイライン矯正
KIREILIGN ORTHODONTICS

2-32. 3Dシミュレーション、セットアップデータの確認方法

3Dシミュレーションは「発送準備中」ステータスになると確認できます

契約分の3Dシミュレーションが付与されます


技工発注画面

① 「技工発注」をクリック

② 該当患者の「注文ID」をクリック

注文詳細画面

③ 画面右上の「シミュレーションを開く」または
「セットアップデータをダウンロード」をクリック

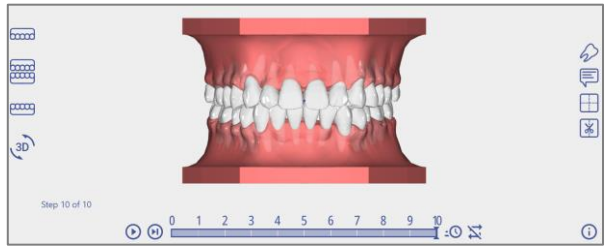

3Dシミュレーション画面のイメージ



契約前シミュレーション / 追加シミュレーションは、メールにて納品されます。

© SheepMedical Co., Ltd.

キレイライン矯正
KIREILIGN ORTHODONTICS

2-33. 契約前/追加シミュレーションの納品

メール納品です

- 契約前シミュレーション　：3Dシミュレーションとシミュレーション詳細PDFをメール添付します
- 追加シミュレーション　　：3Dシミュレーションとシミュレーション詳細PDFをメール添付します



【契約前シミュレーション】ID:35　様

S　SheepMedical 技工所
宛先　歯科
ＣＣ　クリニックサポート

simdocument_420076.pdf .pdf ファイル

医療法人　クリニック
様

平素よりお世話になっております。


ID:35　様

シミュレーション動画を製作致しまし　ご確認のほど宜しくお願いいたします。
今後ともよろしくお願い申し上げます。

SheepMedical

SheepMedical株式会社
住所：〒175-0045　東京都板橋区西台4-3-28
TEL：03-6281-0231＜事務直通＞
050-5526-4602＜技工士直通＞
FAX：03-6281-0232
E-MAIL：laboratory@sheepmedical.com
担当：

イメージ

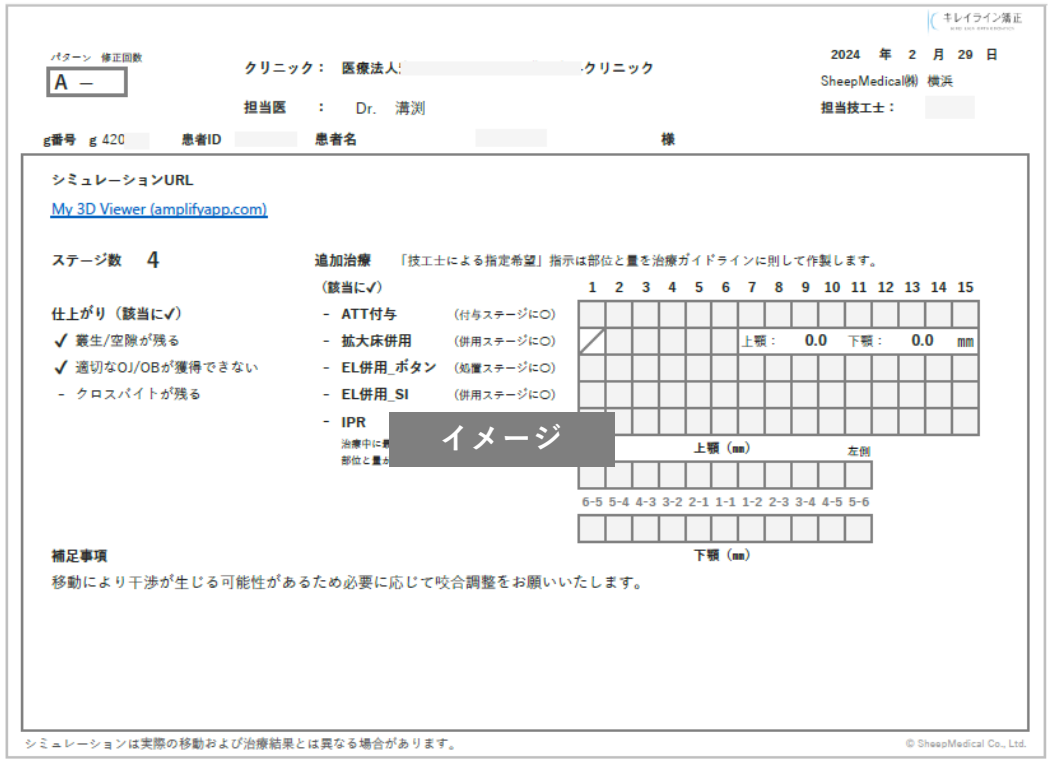

キレイライン矯正

パターン　修正回数
A －

クリニック：　医療法人　クリニック

2024 年 2 月 29 日
SheepMedical(例) 横浜

担当医　：　Dr.　溝渕

担当技工士：

g番号　g 420　患者ID　患者名　様

シミュレーションURL
My 3D Viewer (amplifyapp.com)

ステージ数　4

追加治療　「技工士による指定希望」指示は部位と量を治療ガイドラインに則して作製します。
（該当に✓）

仕上がり（該当に✓）
✓ 叢生/空隙が残る
✓ 適切なOJ/OBが獲得できない
－ クロスバイトが残る

- ATT付与　（付与ステージに○）
- 拡大床併用　（併用ステージに○）
- EL併用_ボタン　（処置ステージに○）
- EL併用_SI　（併用ステージに○）
- IPR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

上顎：　0.0　下顎：　0.0　mm

上顎（mm）　左側

6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6

下顎（mm）

補足事項
移動により干渉が生じる可能性があるため必要に応じて咬合調整をお願いいたします。

シミュレーションは実際の移動および治療結果とは異なる場合があります。

© SheepMedical Co., Ltd.

イメージ

© SheepMedical Co., Ltd.

キレイライン矯正
KIREILIGN ORTHODONTICS

2-34. IPR量、拡大量の確認方法

技工発注画面

① 「技工発注」をクリック

② 該当患者の「注文ID」をクリック

注文詳細画面

③ IPR量、拡大量、技工所メモ等が確認できる





キレイライン矯正
KIREILIGN ORTHODONTICS

2-35. サポートサイトへのアクセス

キレカルからサポートサイトへの導線があります

サポートサイトはIPアドレスを登録するとアクセスできるようになります

① 「サポート資料」をクリック

② サポートサイトを選択








こちらからIPアドレスが確認できます
登録は弊社営業担当までご一報ください


© SheepMedical Co., Ltd.

3. 拡大床について

3-1. 取扱説明

使用時間	1日合計8時間以上（就寝時の装着を推奨）
拡大床効果	週1回の拡大で0.2㎜広がる（ネジを90度回す）
装着方法	アライナーの上からプレート部分をしっかり指で押して装着する （浮いたままの装着では拡大床だけが広がり歯列が拡大されない）
お手入れ方法	矯正用マウスピース専用洗浄剤を使用する
保管	紛失、破損した場合は再製作料が発生
来院時	必ず拡大床を持参する（拡大量が確認できない場合は再来院が必要）

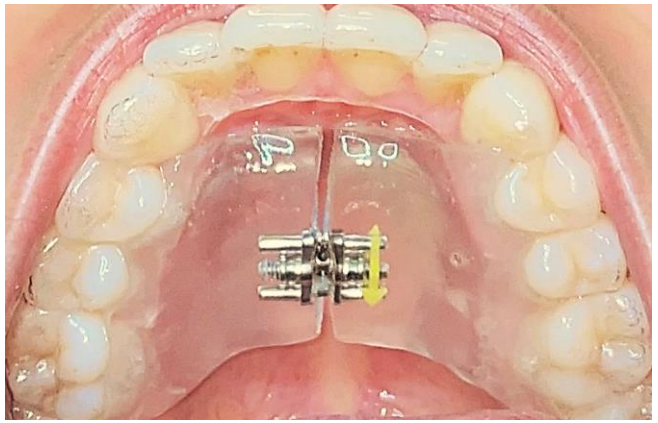

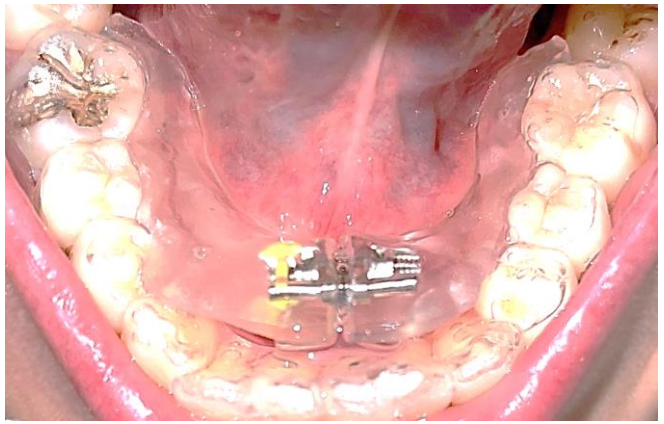

© SheepMedical Co., Ltd.


3-2. 装着方法

アライナーの上に重ねて装着します。アライナーと拡大床の間に隙間がないことを確認してください。
（アライナーと拡大床が適合していないと拡大床だけが広がり適切に歯列が拡大されません）
アライナーの4,6番舌側面に拡大床保持用の突起が付与されています。


拡大床保持用の突起



指の腹でプレートを押さえて装着する

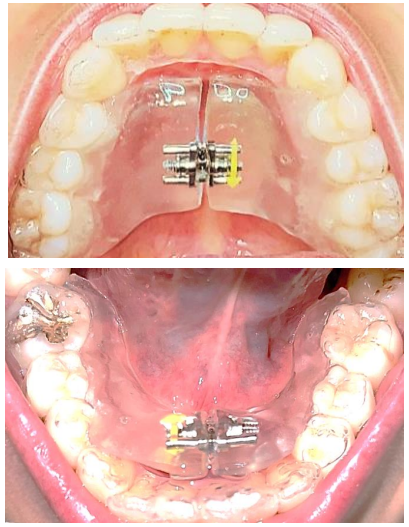

適合

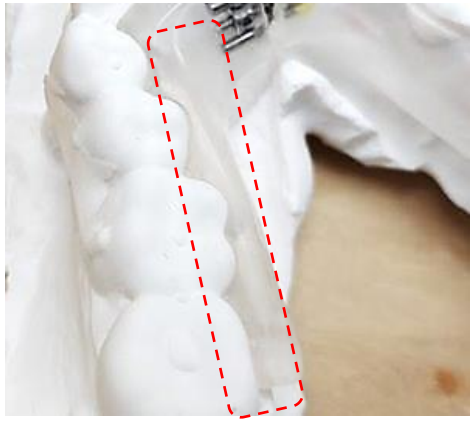

不適合（隙間がある）



© SheepMedical Co., Ltd.

3-3. 外し方


写真の〇の部分のくぼみにリムーバーの先端をひっかけます

1. **上顎4番近心付近のくぼみにリムーバーの先端（ピック状）を差し込んで拡大床を浮かせます**
2. **最後臼歯遠心付近のくぼみにリムーバーの先端（フック状）を引っ掛けて手前に引きあげます**

◆拡大床（上顎）を外す場合

1 リムーバーのフックを拡大床のくぼみ（イラストの赤枠箇所）にかける、もしくはリムーバーの細い方（写真下側）を手前側から差し込みます。

2 くぼみにかけた（差し込んだ）リムーバーを下に引っ張ります。

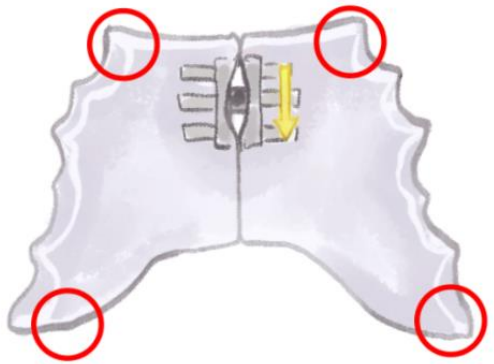

◆拡大床（下顎）を外す場合

1 リムーバーのフックを拡大床のくぼみ（イラストの赤枠箇所）にかけます。

2 くぼみにかけたリムーバーを上に引き上げます。





先端（ピック状）



先端（フック状）

【キレイライン矯正】初回検診予約～治療開始の流れ｜新規契約で全員もらえる初回セットも紹介！ https://kireilign.com/blog/kireilign/4558

© SheepMedical Co., Ltd.

3-4. 拡大方法

1週間に1回拡大します。

拡大床を口腔内から外した状態で拡大します。

中央のネジにピンを挿して倒すとネジが側方に0.2㎜広がります。



1. 上の穴にピンを挿しこむ
2. ピンを黄色の矢印方向に最後まで倒し
   次回拡大用の穴が見えることを確認する

【キレイライン矯正】拡大床の使い方やお手入れ方法、費用まとめ　https://kireilign.com/blog/kireilign/2064

© SheepMedical Co., Ltd.

3-5. 拡大スケジュール表（患者様用）

患者様用の説明資料です。

アライナーの装着期間と拡大のタイミングについて説明してください。




＃123アライナー　上下顎3.0㎜拡大の場合



© SheepMedical Co., Ltd.

3-6. 拡大量の計測方法

来院毎に拡大ネジを計測し拡大量を確認します

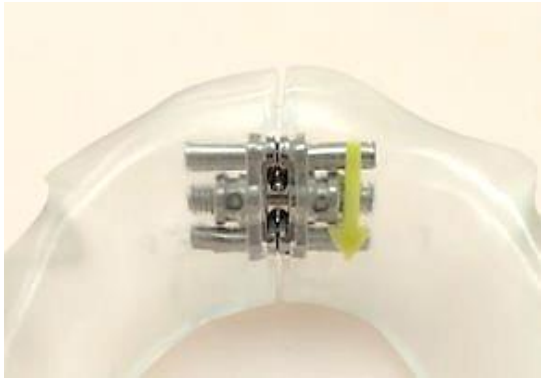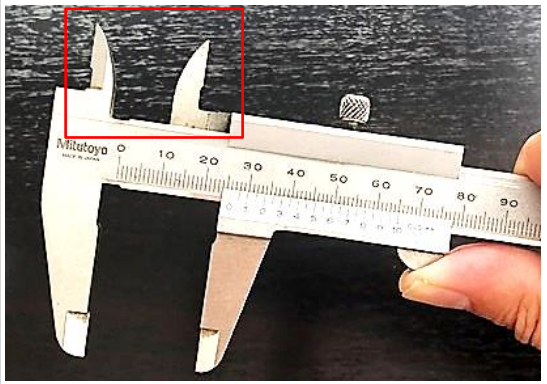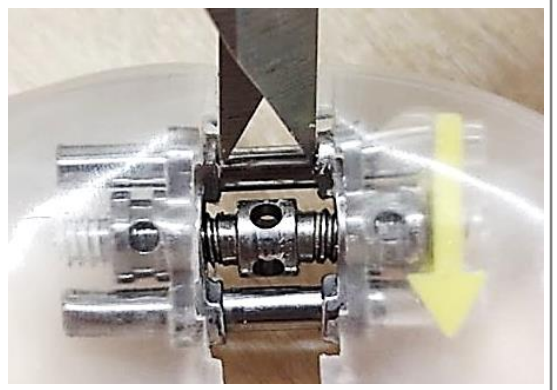拡大ネジが広がる様子		拡大量計測方法	
			
拡大前 床が閉じている	拡大後 床が離開する	内側ジョウ	スクリュー部を 内側ジョウで計測する

© SheepMedical Co., Ltd.


キレイライン矯正
KIREILIGN ORTHODONTICS

3-7. 拡大量の確認方法

キレカルの技工発注の注文詳細画面からセットアップで設定した拡大量が確認できます。

注文詳細画面は印刷できます。



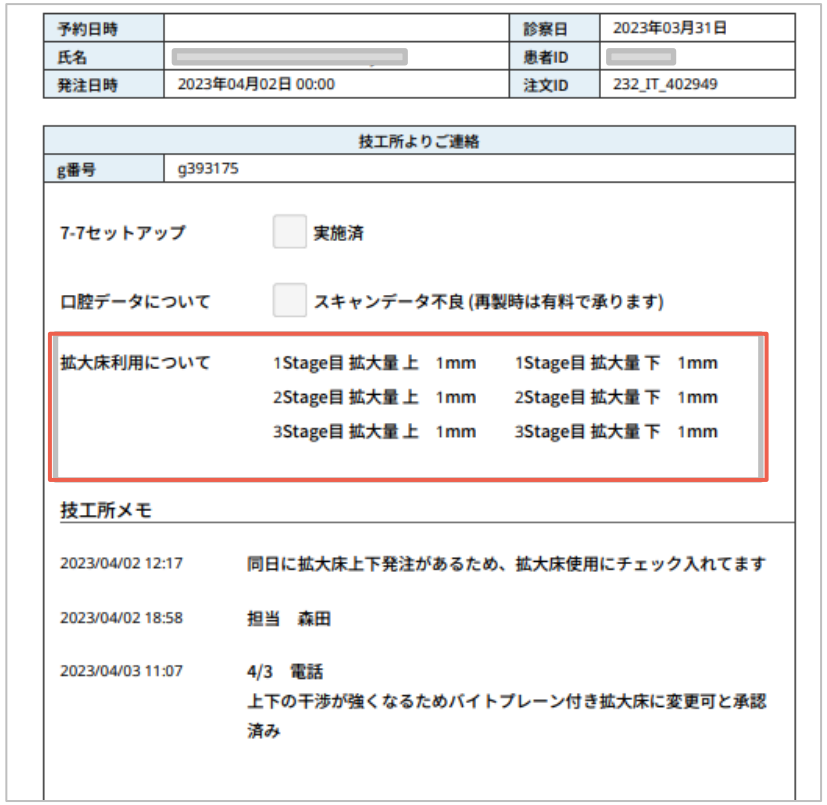

予約日時		診察日	2023年03月31日
氏名		患者ID	
発注日時	2023年04月02日 00:00	注文ID	232_IT_402949

技工所よりご連絡	
g番号	g393175

7-7セットアップ　☐ 実施済

口腔データについて　☐ スキャンデータ不良 (再製時は有料で承ります)

拡大床利用について		
	1Stage目 拡大量 上　1mm	1Stage目 拡大量 下　1mm
	2Stage目 拡大量 上　1mm	2Stage目 拡大量 下　1mm
	3Stage目 拡大量 上　1mm	3Stage目 拡大量 下　1mm

技工所メモ

2023/04/02 12:17	同日に拡大床上下発注があるため、拡大床使用にチェック入れてます
2023/04/02 18:58	担当　森田
2023/04/03 11:07	4/3　電話 上下の干渉が強くなるためバイトプレーン付き拡大床に変更可と承認済み

印刷イメージ

© SheepMedical Co., Ltd.

3-8. リベース

適合しない場合は床を修正します




器具	リベースの手順
• 白色ワセリン • 即時重合レジン • カーボランダムポイント • カーバイトバー • ビッグポイント（茶・グレー）	1. アライナー（リベース付近）にワセリンを薄く塗布する 2. 拡大床リベース部をカーボランダムポイントで削合し新鮮面を出す 3. リベース部に筆積み法でレジンを盛る 4. アライナーの上から拡大床を装着し拡大床を把持しながらレジンの硬化を待つ 5. 拡大床とアライナーを口腔内から取り出し拡大床についているバリを除去しビッグポイントで研磨する 6. アライナーに付着したレジンとワセリンを拭き取る  

© SheepMedical Co., Ltd.

Appendix

口腔内3Dスキャン（NG例1）

次の場合は再スキャンが必要です

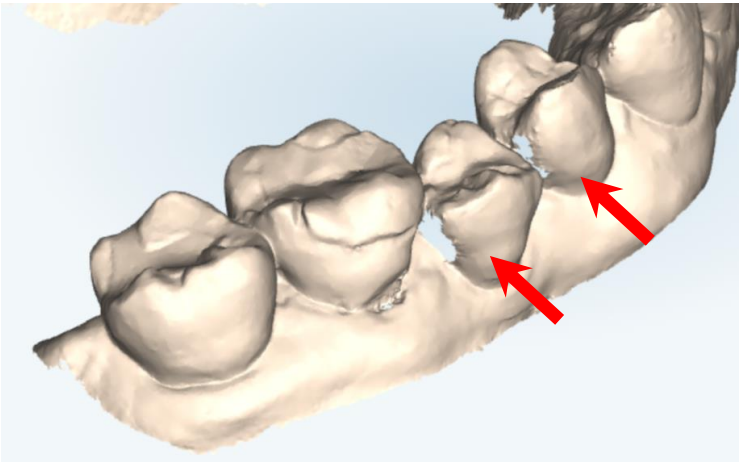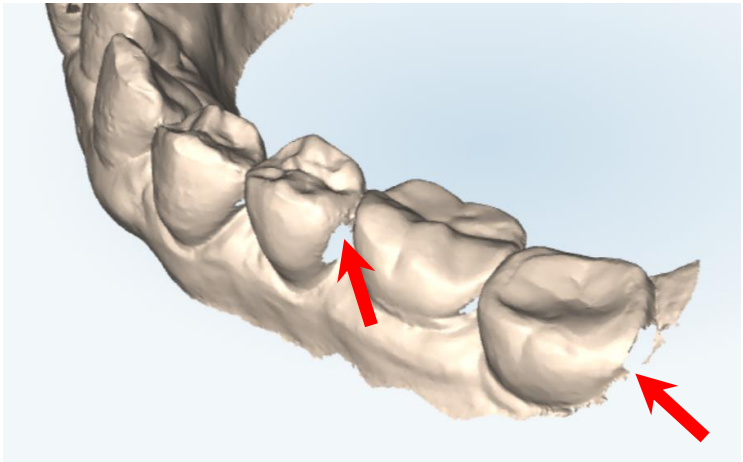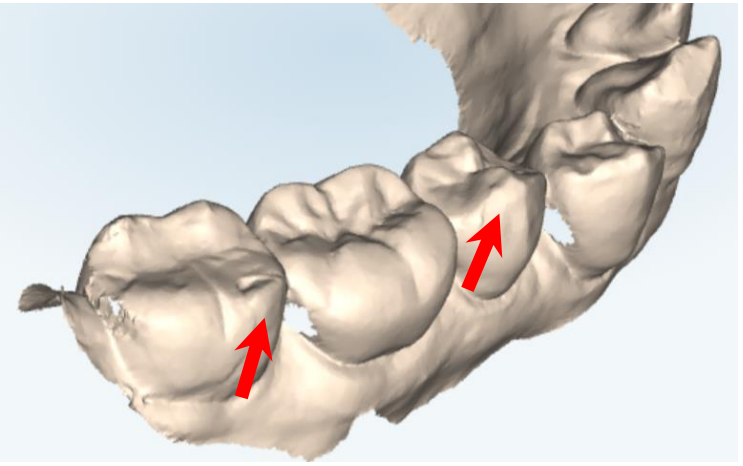		
鼓形空隙付近がとれていない	鼓形空隙付近がとれていない 最後臼歯の歯頸部付近がとれていない	鼓形空隙付近がとれていない




鼓形空隙付近がとれない原因として、唾液等の気泡が残っている可能性が考えられます。

口腔内の該当箇所にエアーを吹き付けて気泡を除去し、再スキャンしてください。

© SheepMedical Co., Ltd.

口腔内3Dスキャン（NG例2）

次の場合は再スキャンが必要です

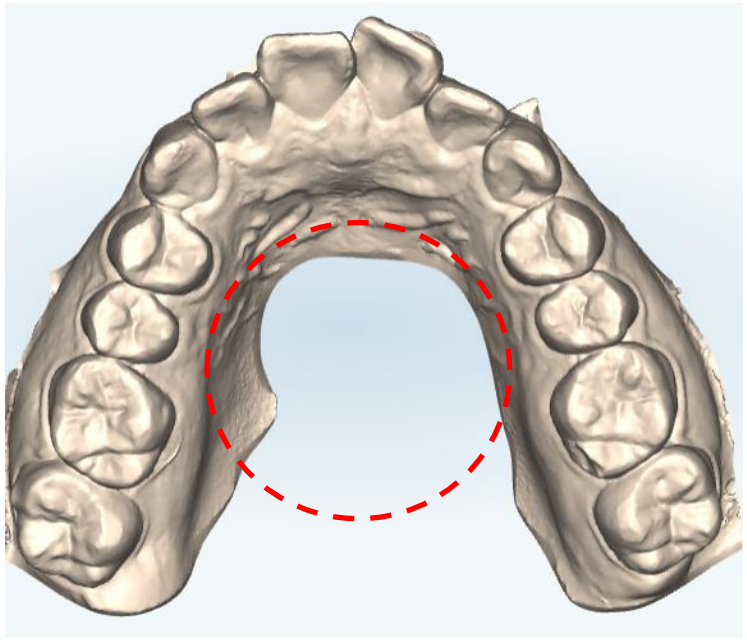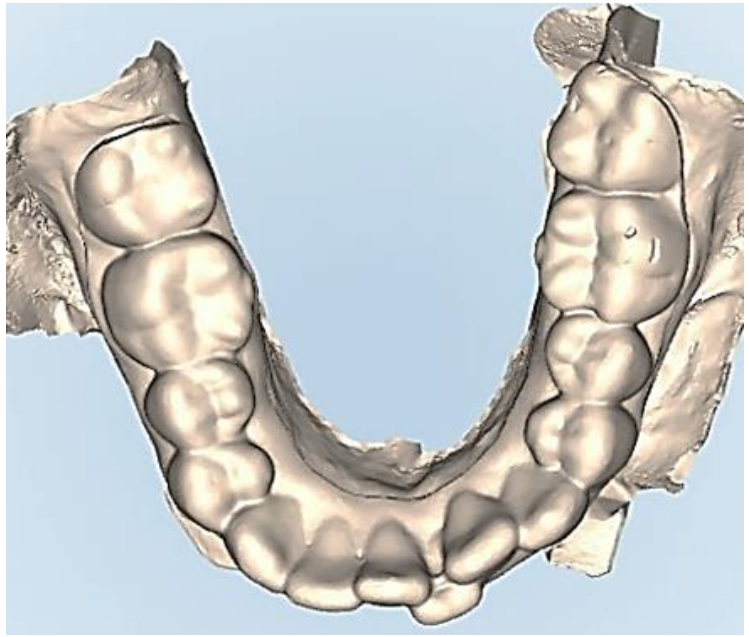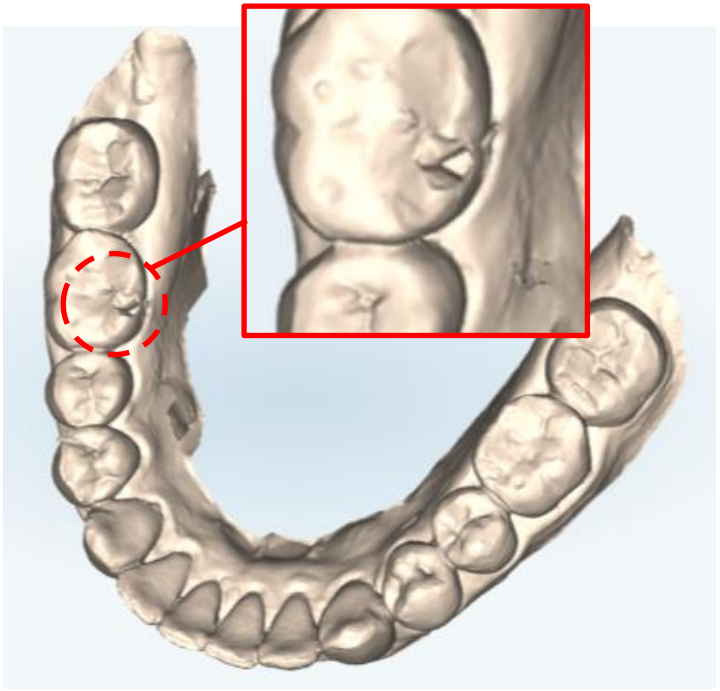
		
上顎口蓋がとれていない	余分なバリが多い	咬合面に穴が開いている

拡大床の製作には上顎口蓋がとれているデータが必要です

© SheepMedical Co., Ltd.

顔貌写真（NG例1）

次の場合は再撮影が必要です

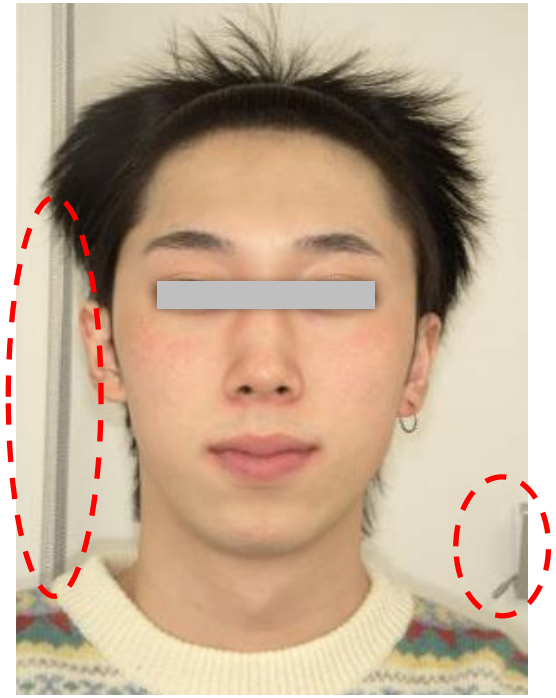		
真横ではない 〔Profile, E-lineが正確に確認できる真横から撮影する〕	背景に写り込みがある 〔白や青の1色背景で撮影する〕	耳が隠れている 〔耳を出して顔の輪郭を鮮明に撮影する〕

© SheepMedical Co., Ltd.

顔貌写真（NG例2）


次の場合は再撮影が必要です

		
耳と顎のラインが隠れている 〔耳を出して横顔の輪郭を鮮明に撮影する〕	マスクを装着している 〔E-lineを正確に判断できるようマスクを外して撮影する〕	眼鏡を装着している 〔Profileが正確に判断できるよう眼鏡を外して撮影する〕

© SheepMedical Co., Ltd.

顔貌写真（NG例3）

次の場合は再撮影が必要です

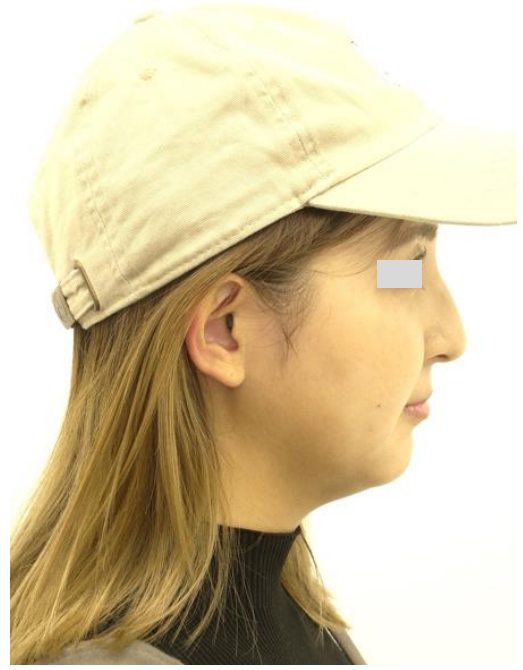		
背景に写り込みがある エプロンをしたまま撮影している 横臥位で撮影している 〔背景が無地の場所でエプロンを外し立位で撮影する〕	広範囲で撮影している 〔胸上（鎖骨の少し下くらいまで）を撮影する〕	帽子を装着している 〔Profileが正確に判断できるよう帽子を外して撮影する〕

© SheepMedical Co., Ltd.

口腔内写真（NG例1）


次の場合は再撮影が必要です

		
噛んでいない 〔中心咬合位で噛ませて撮影する〕	7番が口唇で一部隠れている 〔最後臼歯まで撮影する〕	ミラーが曇っている 開口量が足りない 〔曇りに注意し最大開口量で撮影する〕

© SheepMedical Co., Ltd.

口腔内写真（NG例2）


次の場合は再撮影が必要です

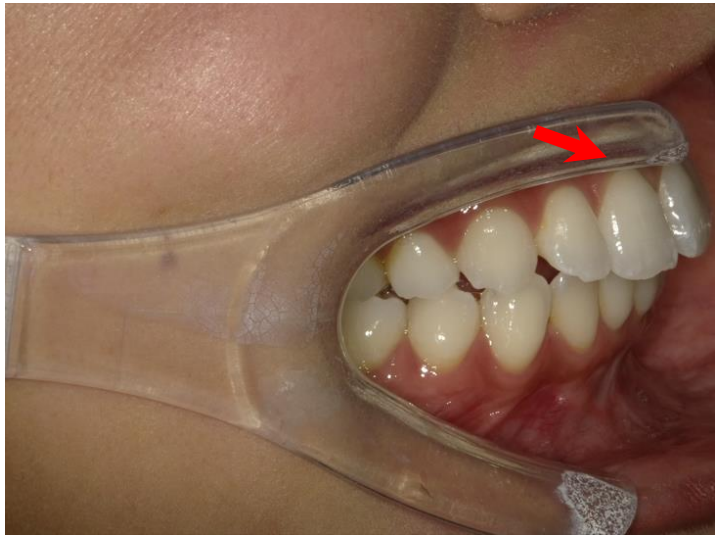		
前から撮りすぎで反対側の1番がほぼ写っている 〔可能な範囲で真横から撮影する〕	口角鈎が歯面とかぶっている 6番が隠れている 〔歯面にかぶらないように口角鈎を引いて6番まで見えるように撮影する〕	口角鈎のサイズが不適切 6番が隠れている 手指で口唇を排除している 〔適切なサイズの口角鈎を使用し6番まで見えるように撮影する〕

© SheepMedical Co., Ltd.

口腔内写真（NG例3）



次の場合は再撮影が必要です

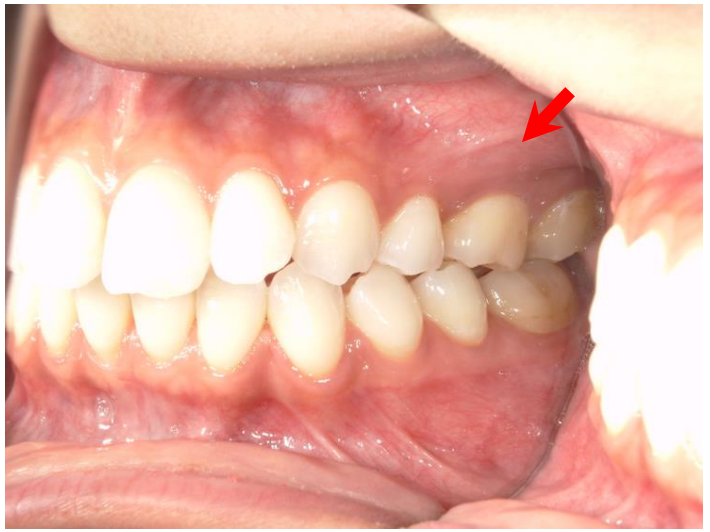		
ピントが合っていない 〔ピントを合わせる〕	ミラーを使って撮影している 〔側方写真は真横の撮影が難しいためミラーを使用して撮影しない〕	ミラーを使用せず下顎を撮影している 〔下顎全体が撮影できるようミラーを使用する〕

© SheepMedical Co., Ltd.

口腔内写真（NG例4）


次の場合は再撮影が必要です

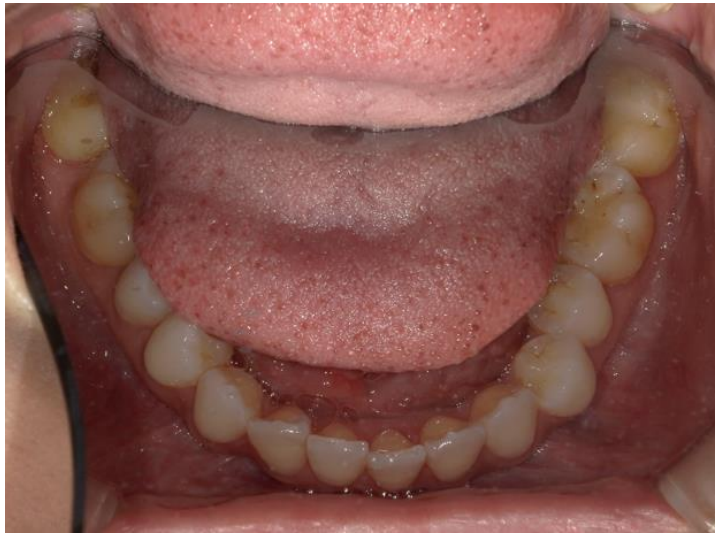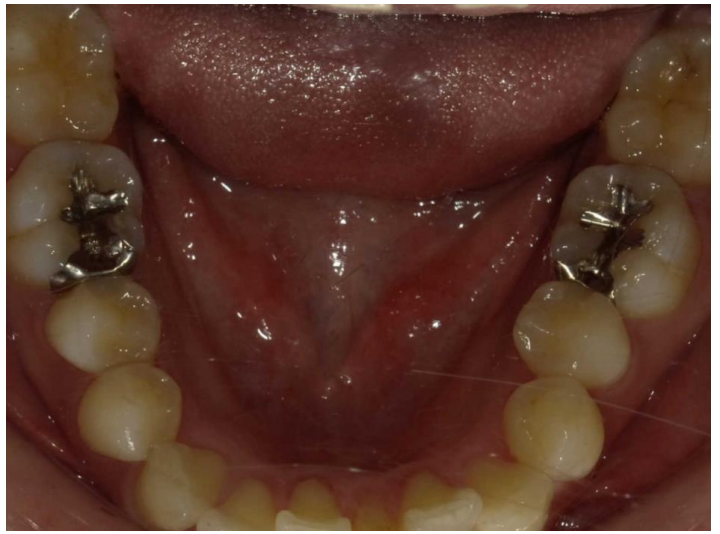
		
口角鈎を使わずミラーのみで撮影している 〔下顎全体が撮影できるよう口角鈎も使用する〕	舌が歯面にかぶっている 〔歯面にかぶらないように舌を下げて撮影する〕	前歯部が切れている 〔下顎全体が入るように撮影する〕

© SheepMedical Co., Ltd.

アタッチメント付与

①テンプレートカット

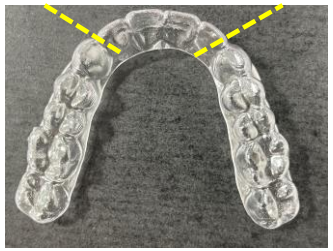

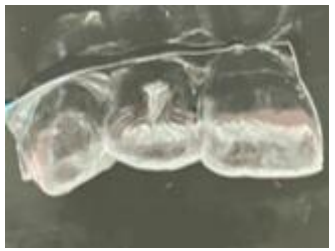

セットしやすくするために3ブロック
または隣在歯がある状態にカットします

②プラーク除去





歯面を清掃してテンプレートを試適します


③エッチング・ボンディング



**エッチング
範囲が広いと
余剰レジンが
取り辛くなります**

テンプレートでATTの付与位置を確認します
（通常は歯冠中央に付与されています）

④アタッチメント付与

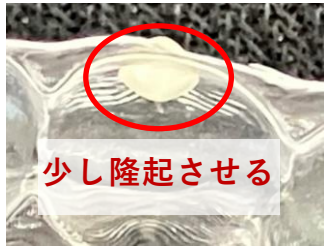






1. 中粘度のCRをテンプレートの窪み（ATT）へ**隆起するように少し多めに**注入します
   ※量が不足していると接着しない/脱落する原因になります
2. テンプレートを装着して密着させます
3. 手指で押さえるまたはロールワッテをかませて**圧接させた状態**で照射します

⑤テンプレートをはずす



唇側面から慎重に外します
テンプレートは使い捨てです

⑤バリ除去

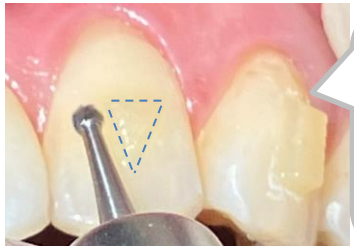

バリが残っているとATTがフィットせず効果が減少してしまいます

大きいバリ：スケーラー
アタッチメント周囲：ラウンドバー等
を使用してバリを**<u>確実に除去</u>**します

© SheepMedical Co., Ltd.

空隙について

空隙はスキャンデータでは確認できないことが多いため

空隙は必ず技工指示書に全て記載してください

空隙量を把握していないと動きが悪くなってしまったり、最終的にスペースが残り追加アライナーが必要になる可能性があります

技工指示書への記入方法



スペースの測り方

歯と歯の間にコンタクトゲージを挿入します





少し抵抗しながら挿入できるmm数とします


例）0.2のゲージが抵抗なく入り、0.25のゲージが少し抵抗しながら入る

＝歯と歯の隙間は0.25mm


© SheepMedical Co., Ltd.

スキャン時の注意と空隙量記載の重要性

唾液や食渣/歯石が残っていると
スペースが確認できません
➡歯面清掃後、しっかりと
エアーで飛ばしてからスキャンをします

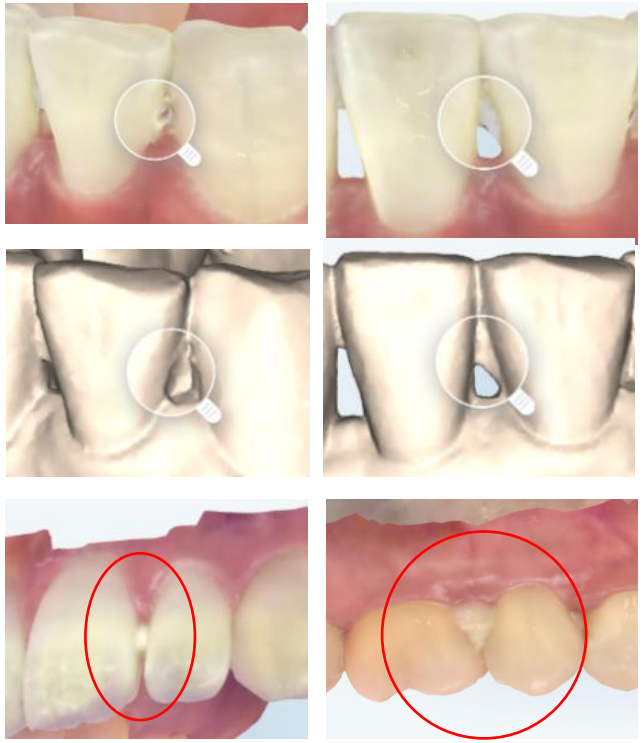


叢生が多い部分は
スキャン漏れが起きやすい
➡段差を撮るには
エアーで唾液をしっかり飛ばし
色々な角度から撮影します

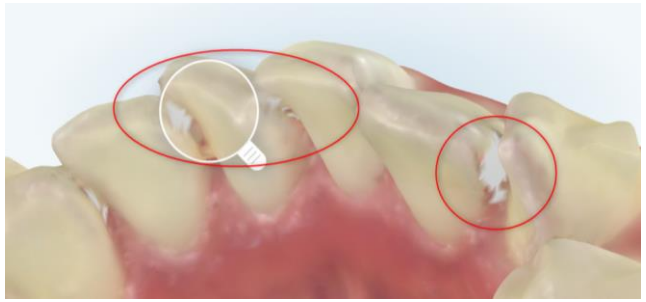

コンタクト部分の確認ができず
移動量の適切な設定ができません。
歯が予定通り動かない/叢生や空隙
が残るなど、追加のアライナーが
発生してしまいます

唾液を飛ばしたとしてもデザインソフト上
ではくっついてしまうことがあります
➡空隙残りは必ず技工指示書へ
全て記載します

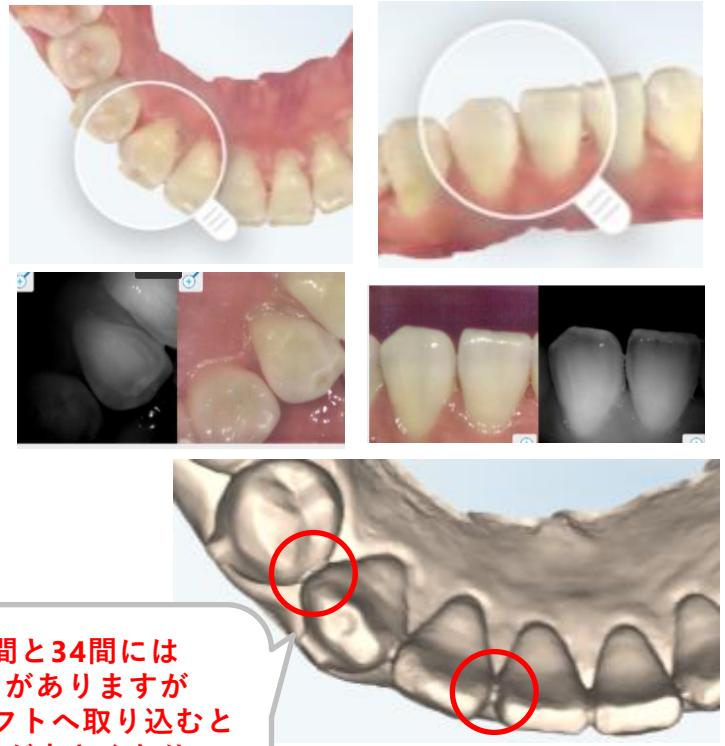

左下12間と34間には
スペースがありますが
デザインソフトへ取り込むと
歯冠形態が大きくなり
スペースが無いように
表現されてしまいます

© SheepMedical Co., Ltd.

〔初回検診ご予約フォーム〕からの予約以降のメール配信タイミング

クリニック様 操作

カテゴリ	操作	配信方法	患者様への配信内容
問診票の入力依頼	キレカルの患者情報画面から、左メニューの「問診票」をクリックして、事前問診票案内SMS送信画面の「SMSを送信する」をクリック	SMS	本文　：　アプリから問診票入力が行えます

患者様 操作

カテゴリ	操作	配信方法	配信内容
初回の予約	初回検診ご予約フォームから初回予約	Email	タイトル：　【キレイライン】重要！ 予約に関して、必ず一読ください。（＊1）
予約の変更	（＊1）のメール本文「なお、ご予約日の前日・当日のキャンセルは、お電話でのみ承っております。」の下にあるリンクをクリック	Email	タイトル：　【キレイライン】予約変更を承りました
予約のキャンセル※	（＊1）のメール本文「なお、ご予約日の前日・当日のキャンセルは、お電話でのみ承っております。」の下にあるリンクをクリック	Email	タイトル：　【キレイライン】予約キャンセルを承りました

自動配信

カテゴリ	条件	配信方法	配信内容
問診票入力確認	来院予定日の３日前（問診票未入力の場合のみ）	SMS	本文　：　ご予約日が近づいてまいりました。問診票の入力が済んでいない方は以下のページからご入力ください。当日の受付がスムーズになります。
予約確認	来院予定日の14日前	SMS	本文　：　キレイライン初回検診の２週間前となりました
	来院予定日の５日前	SMS	本文　：　ご予約日が近づいてまいりました。ご予約情報のご確認をお願いいたします。
	来院予定日の1日前	SMS	本文　：　明日はキレイラインの初回検診です
アンケート依頼	来院1時間以降にアンケート依頼メール	Email	タイトル：　【重要：アンケート回答依頼】　ご来院ありがとうございました

※ ご予約日の前日・当日のキャンセルはお電話でのみ

© SheepMedical Co., Ltd.



免責事項

ここに記載する情報は、当法人が正確を期して提供しておりますが、その正確性、有用性、確実性について保証するものではなく、一切の責任を負わないものといたします。

また、これらの情報は各々の判断と責任によってご利用いただくものであり、医療診断または治療の代用として利用されることは意図されておらず、また想定もしておりません。

なお、情報をより正確かつ適切にご利用いただくために、予告無く内容の修正、変更、削除をおこなう場合がありますが、それらによって生じるいかなる損害についても一切の責任を負わないものといたします。